Ritter® by MIDMARK

224 / 225 Barrier-Free® Power Examination Chair Setup Instructions


Tools:
Battery Powered Drill / Impact Driver
Standard Wrench Set
Standard Deep Well Socket Set
Box Cutter
Furniture Dolly (4 Wheel)

Caution
Heavy object. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving chair to minimize muscle strains or back injury.

Equipment Alert
When moving the chair, you must adhere to the following instructions.

ALWAYS: *a) Transport chair in full-down position with base shroud supports in place.*

NEVER: *a) Push on base shrouds.*
b) Lift chair by stirrups, back section, or upholstered top.

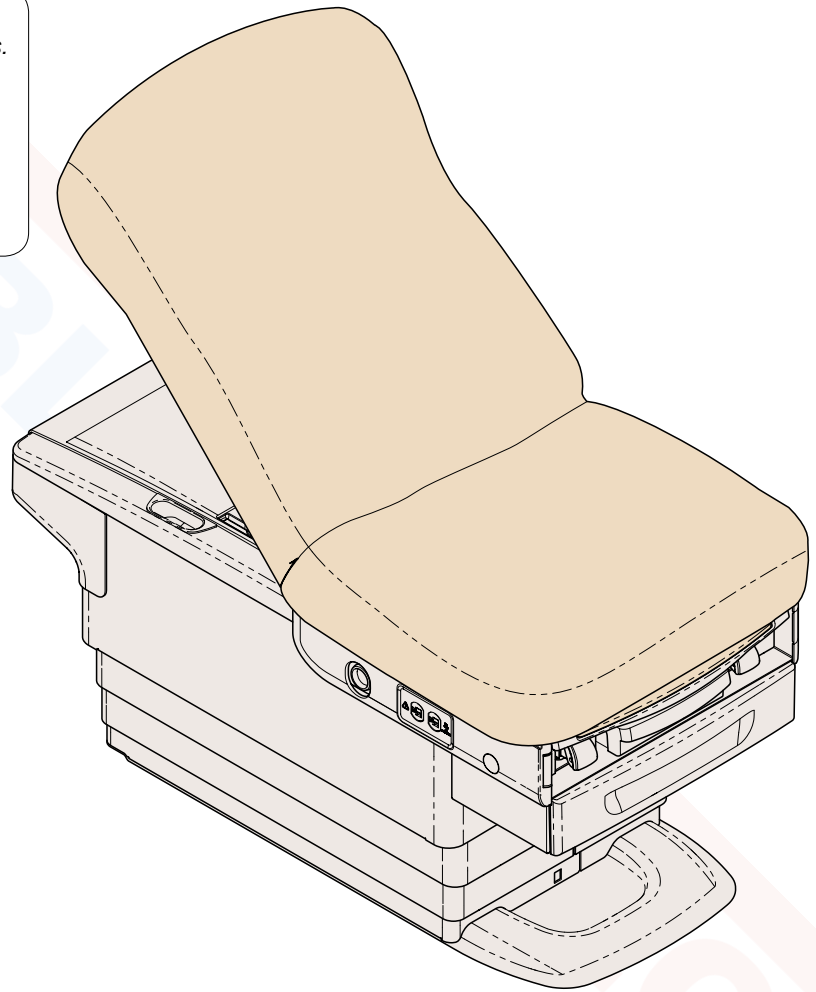


MA10250i

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com


TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169 Style A **003-10033-99 Rev. AA6 (9/25/19)**

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com


Step 1:
Remove brackets (4) from skid to release chair.

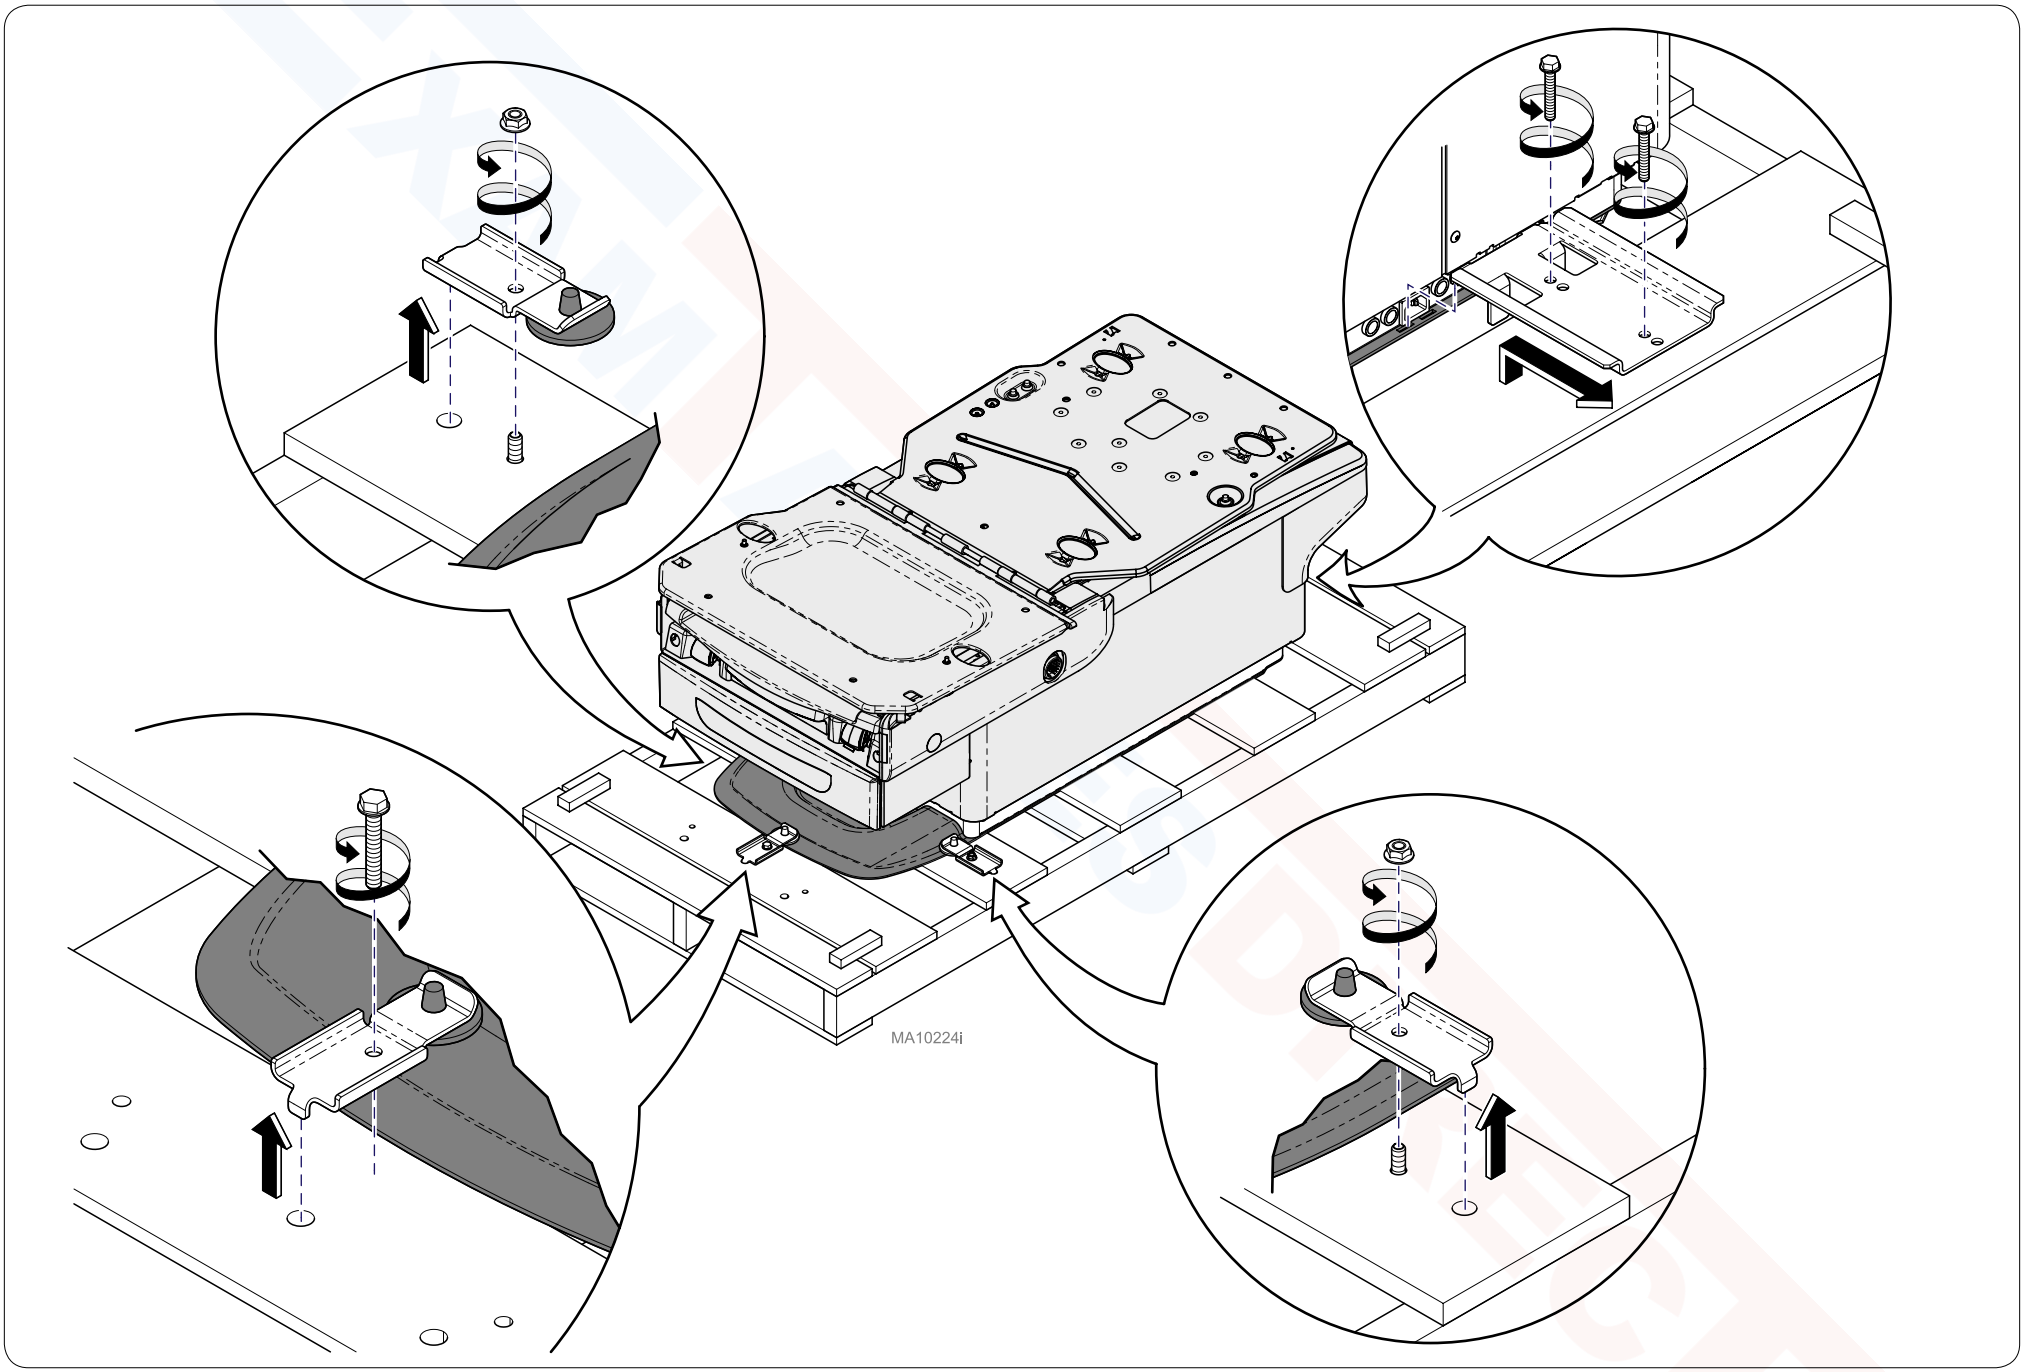


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

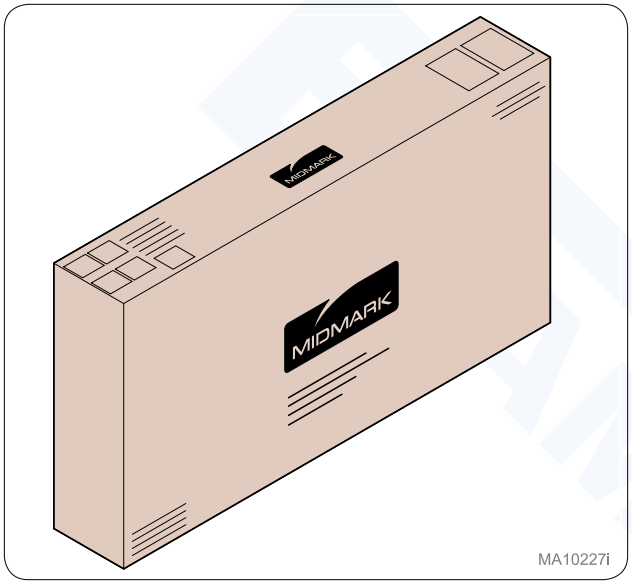


Step 2:
Locate box containing upholstery.

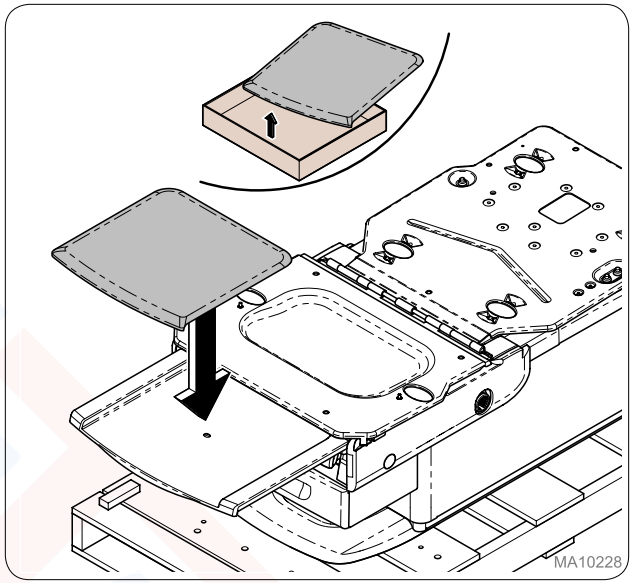


Step 3:
Place footrest upholstery, inserting pin on bottom of upholstery into footrest shelf hole.

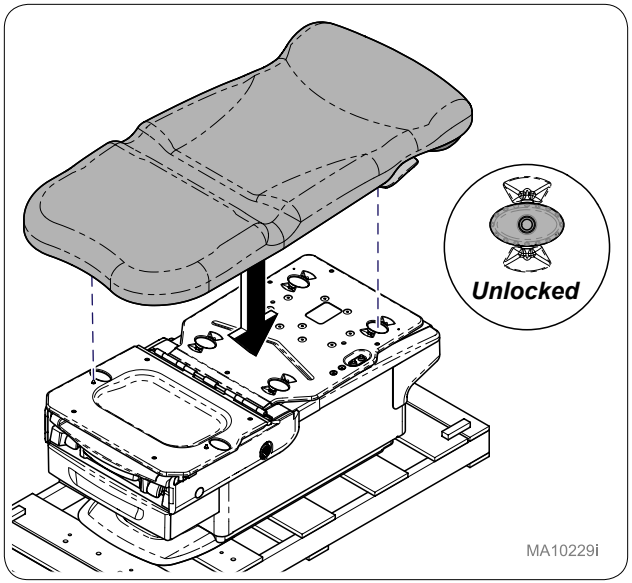


Step 4:
With locking knobs (4) in the unlocked position, place upholstery on chair top aligning locking knobs with holes.

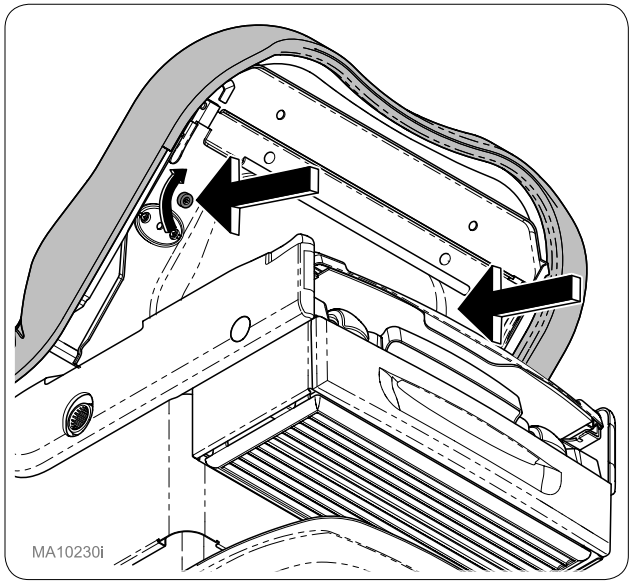

Step 5:
Raise seat pan 90 degrees and secure seat section using attached thumb screws (2). Lower seat pan.

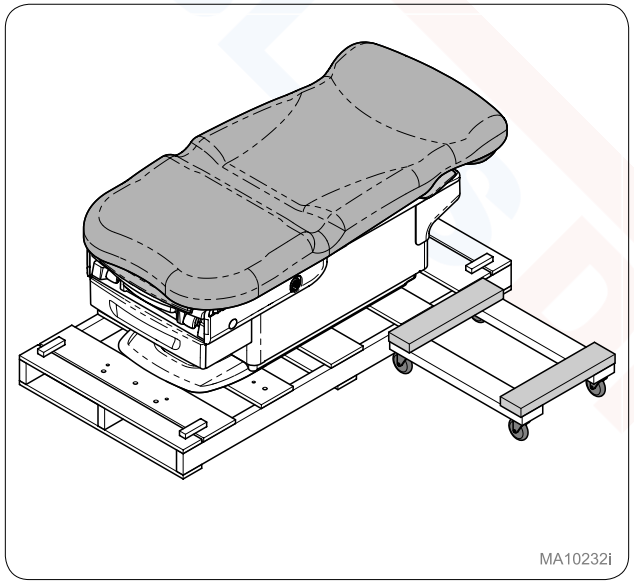

Step 6:
Place dolly next to head end of chair.

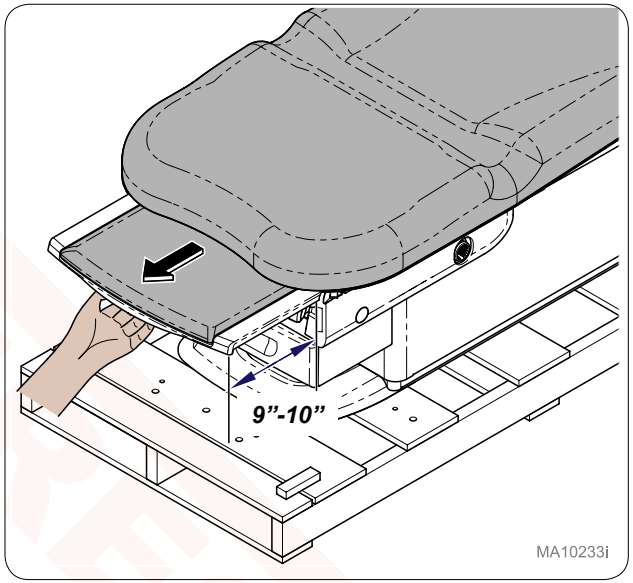


Step 7:
Slide footrest 9”-10” out of chair.


© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

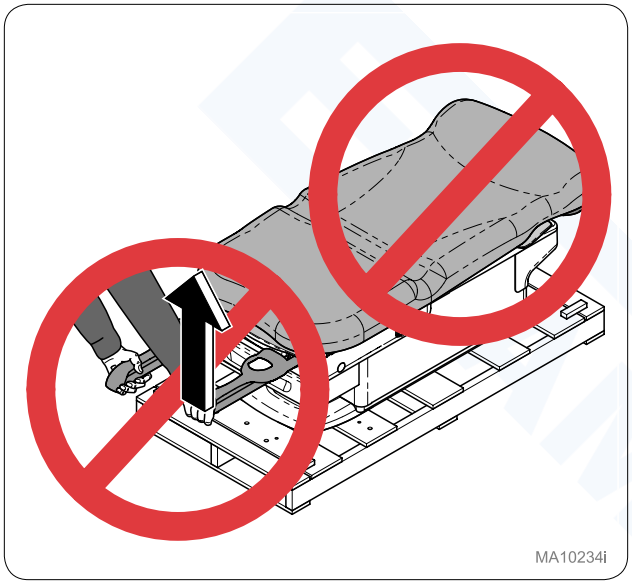


Equipment Alert
*Do **NOT** lift chair by Upholstery or Stirrups.*

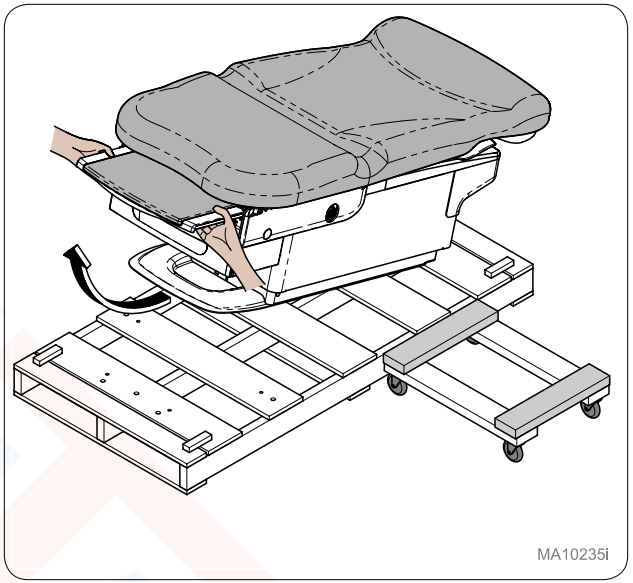


Step 8:
Using proper lifting technique, lift chair off front of skid.

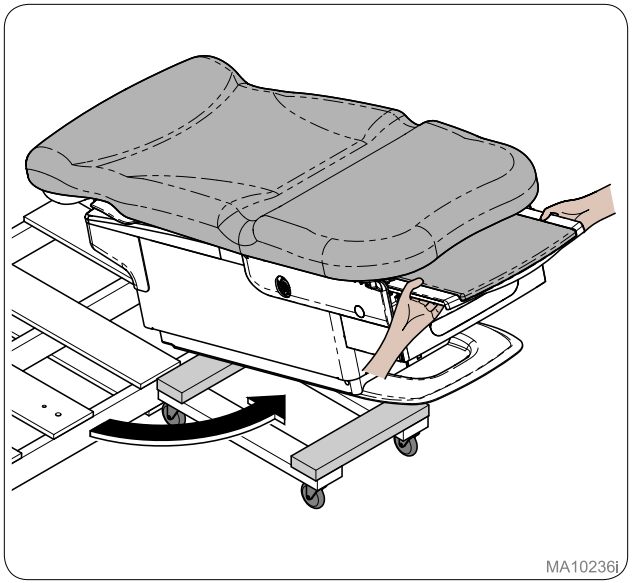


Step 9:
Rotate chair to dolly.

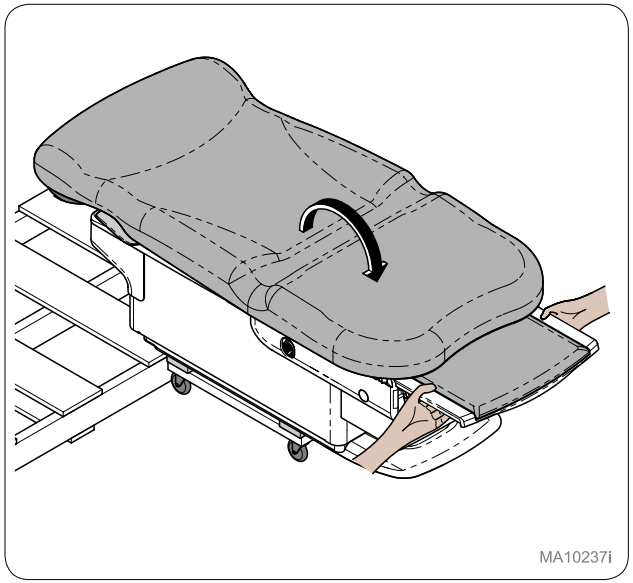

Step 10:
Lower chair onto dolly.

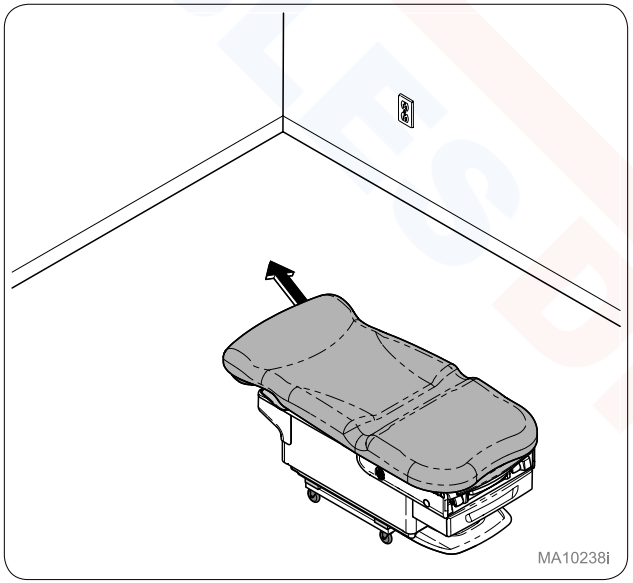

Step 11:
Move chair to desired location.

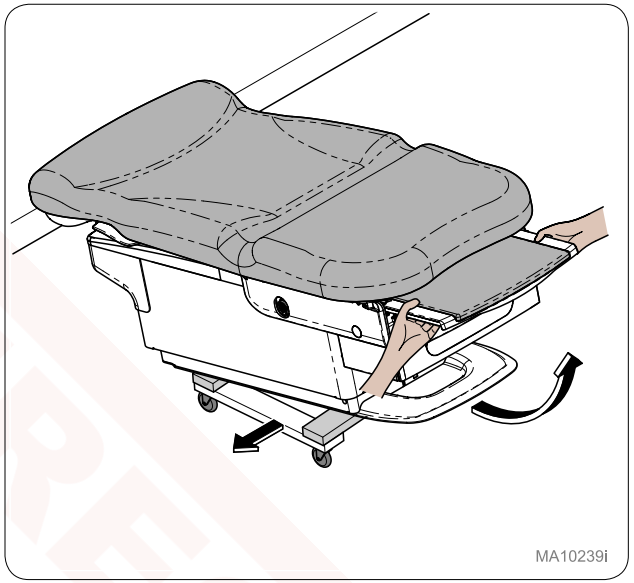


Step 12:
Remove chair from dolly.

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com


TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com


Before connecting the Midmark device power cord into an electrical power source outlet, it is recommended to contact a local licensed electrician or a local Authority Having Jurisdiction over the internal building power distribution to verify that the device when powered up will comply with all local, state, and federal electrical codes. Use the electrical power rating marked on the device when determining the appropriate electrical branch circuit and outlet requirements. For 115V rated device models with a current rating at or above 12 Amps, a dedicated branch circuit may be required if the branch circuit protection is provided by a 15 Amp breaker.

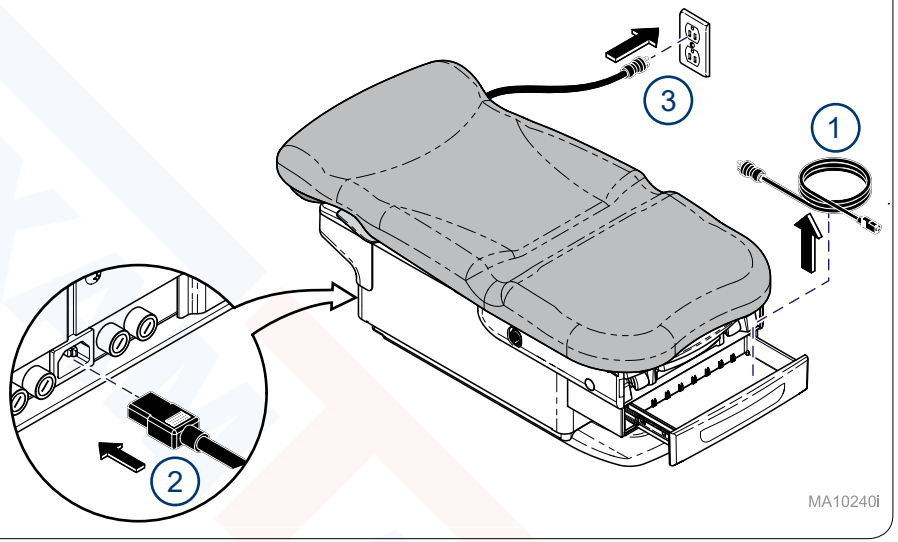


Step 13:
Remove power cord from drawer, connect to rear of chair, and plug into wall or floor outlet.

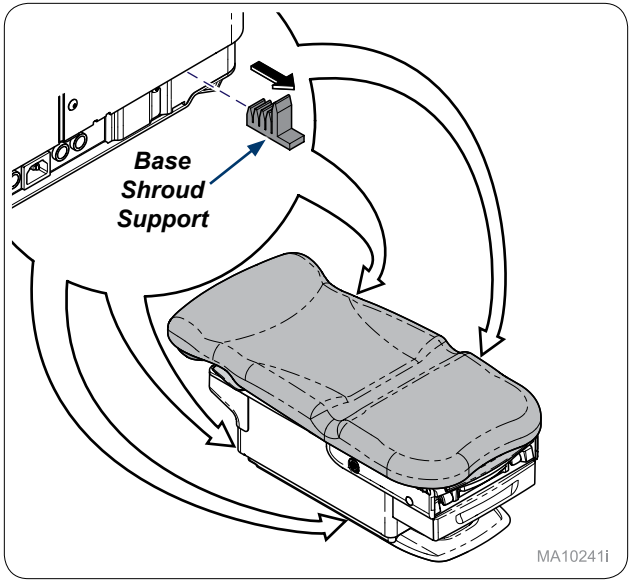


Step 14:
Remove base shroud supports (4).

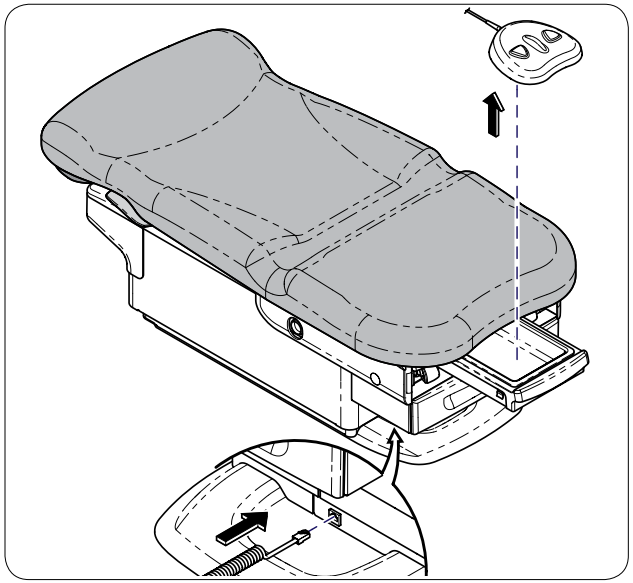

Step 15:
Remove foot control from treatment pan.
Connect foot control to front base of chair.

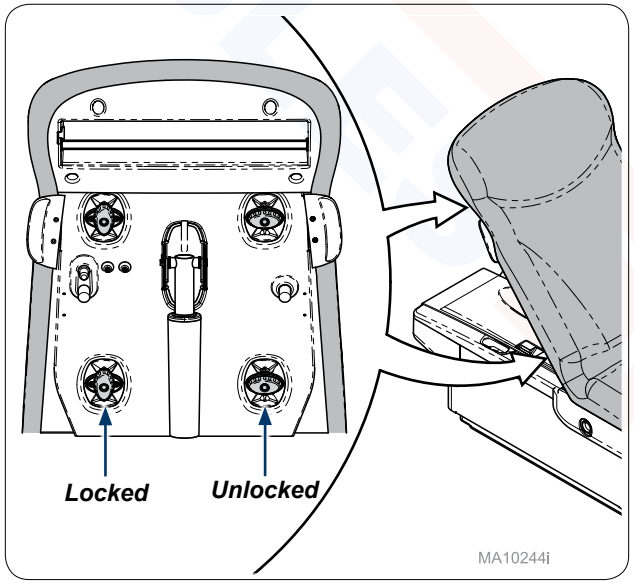

Step 16:
Raise back and latch upholstery locking knobs (4).

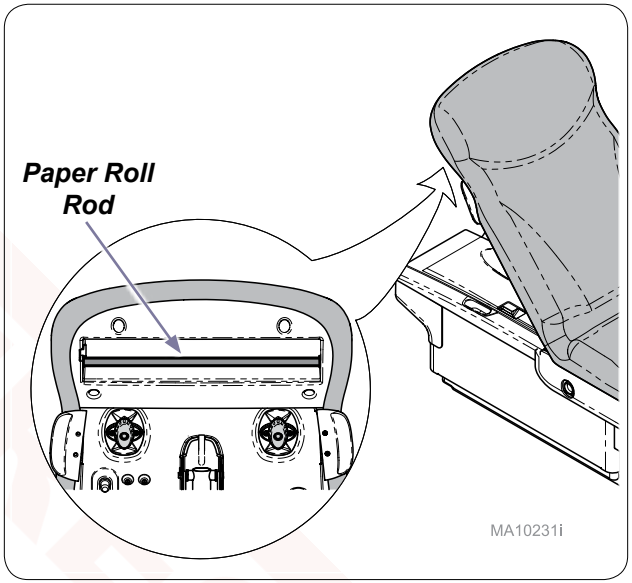


Step 17:
Ensure paper roll rod is in place.

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1-800-643-6275 | 1-937-526-3662 | midmark.com


TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Equipment Alert
The chair must be leveled or stable to ensure proper operation.

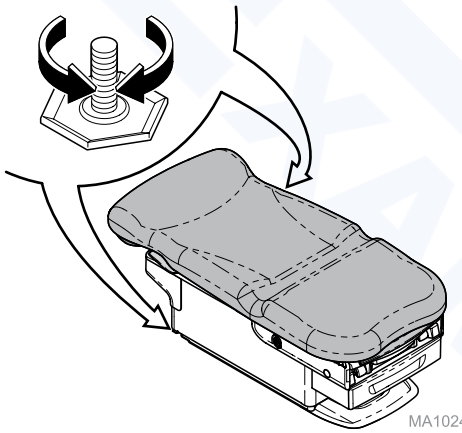


Step 18:
Adjust leveling screws (2) at head end of chair to level or balance chair.

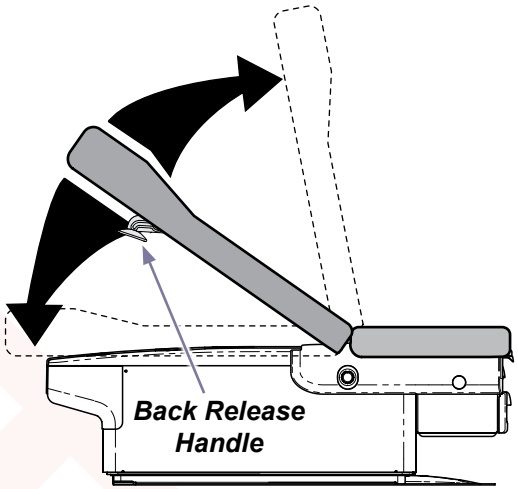

Step 19: (224 Only)
Verify proper manual Back operation.

Note
If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1-800-MIDMARK.

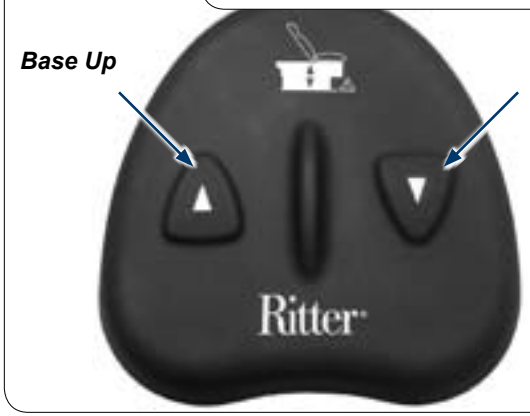


Step 20: (224 Only)
Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down.

Note
If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1-800-MIDMARK.



Step 21: (225 Only)
Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down and Back Up/Down.

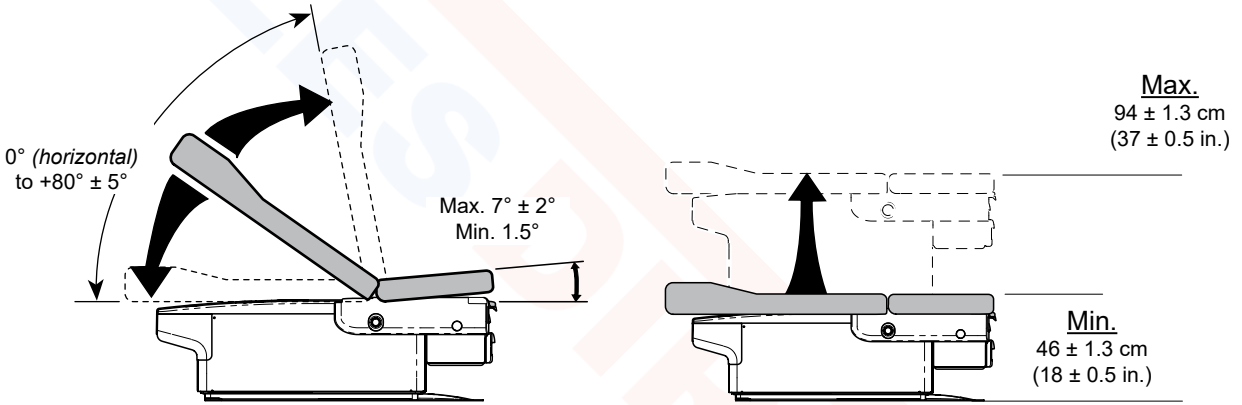

Chair range of motion.

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Ritter® by MIDMARK

224 / 225 Fauteuil d'examen à commande électrique Barrier-Free® Instructions de montage


Outils :
Perceuse sans fil/Visseuse à percussion
Jeu de clés standard
Clé à douille profonde standard
Couteau polyvalent
Chariot à roulettes (4 roues)

Attention
Objet lourd. Utiliser des dispositifs de levage et appliquer des techniques de levage appropriées lorsque vous manipulez le fauteuil afin d'éviter tout risque de claquage ou de douleurs au dos.

Avertissement concernant l'équipement
Lorsque vous déplacez le fauteuil, vous devez respecter les instructions suivantes.

TOUJOURS: *a) Transporter le fauteuil en position complètement abaissée avec les supports de revêtement de l'assise en position.*


NE JAMAIS: *a) Appuyer sur les revêtements de l'assise.*
b) Soulever le fauteuil par les étriers, le dossier ou la pièce de garniture supérieure.

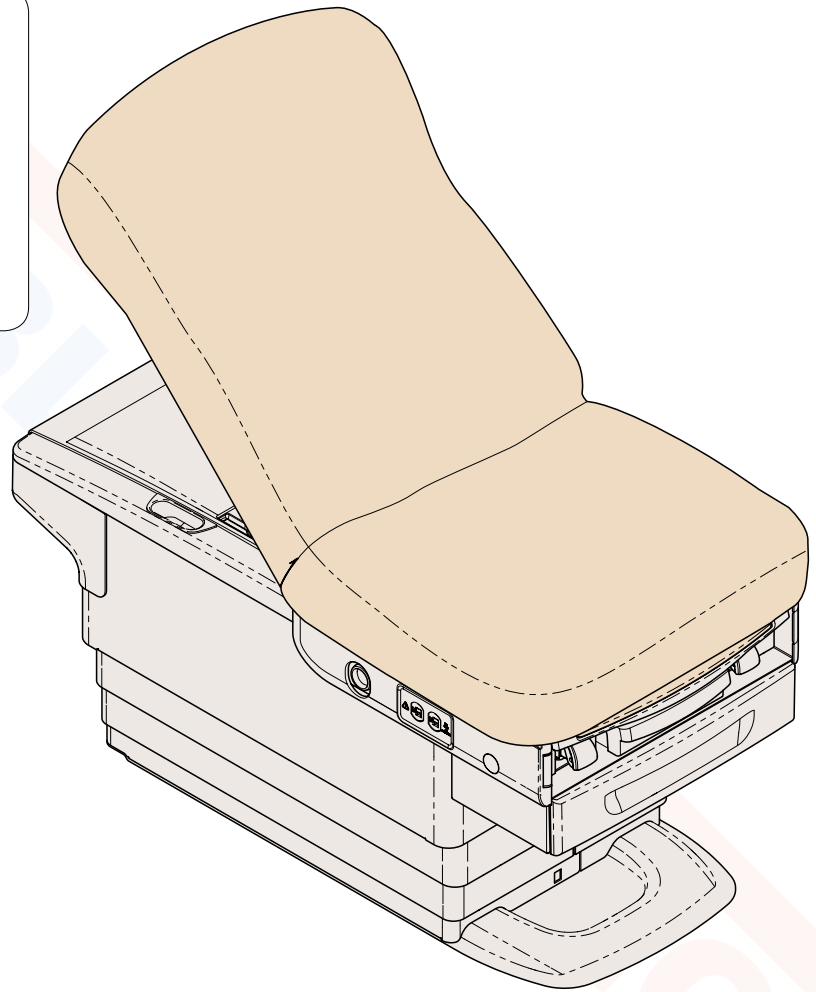


MA10250i

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com


Étape 1 :
Retirer les supports (4) de la palette pour libérer le fauteuil.

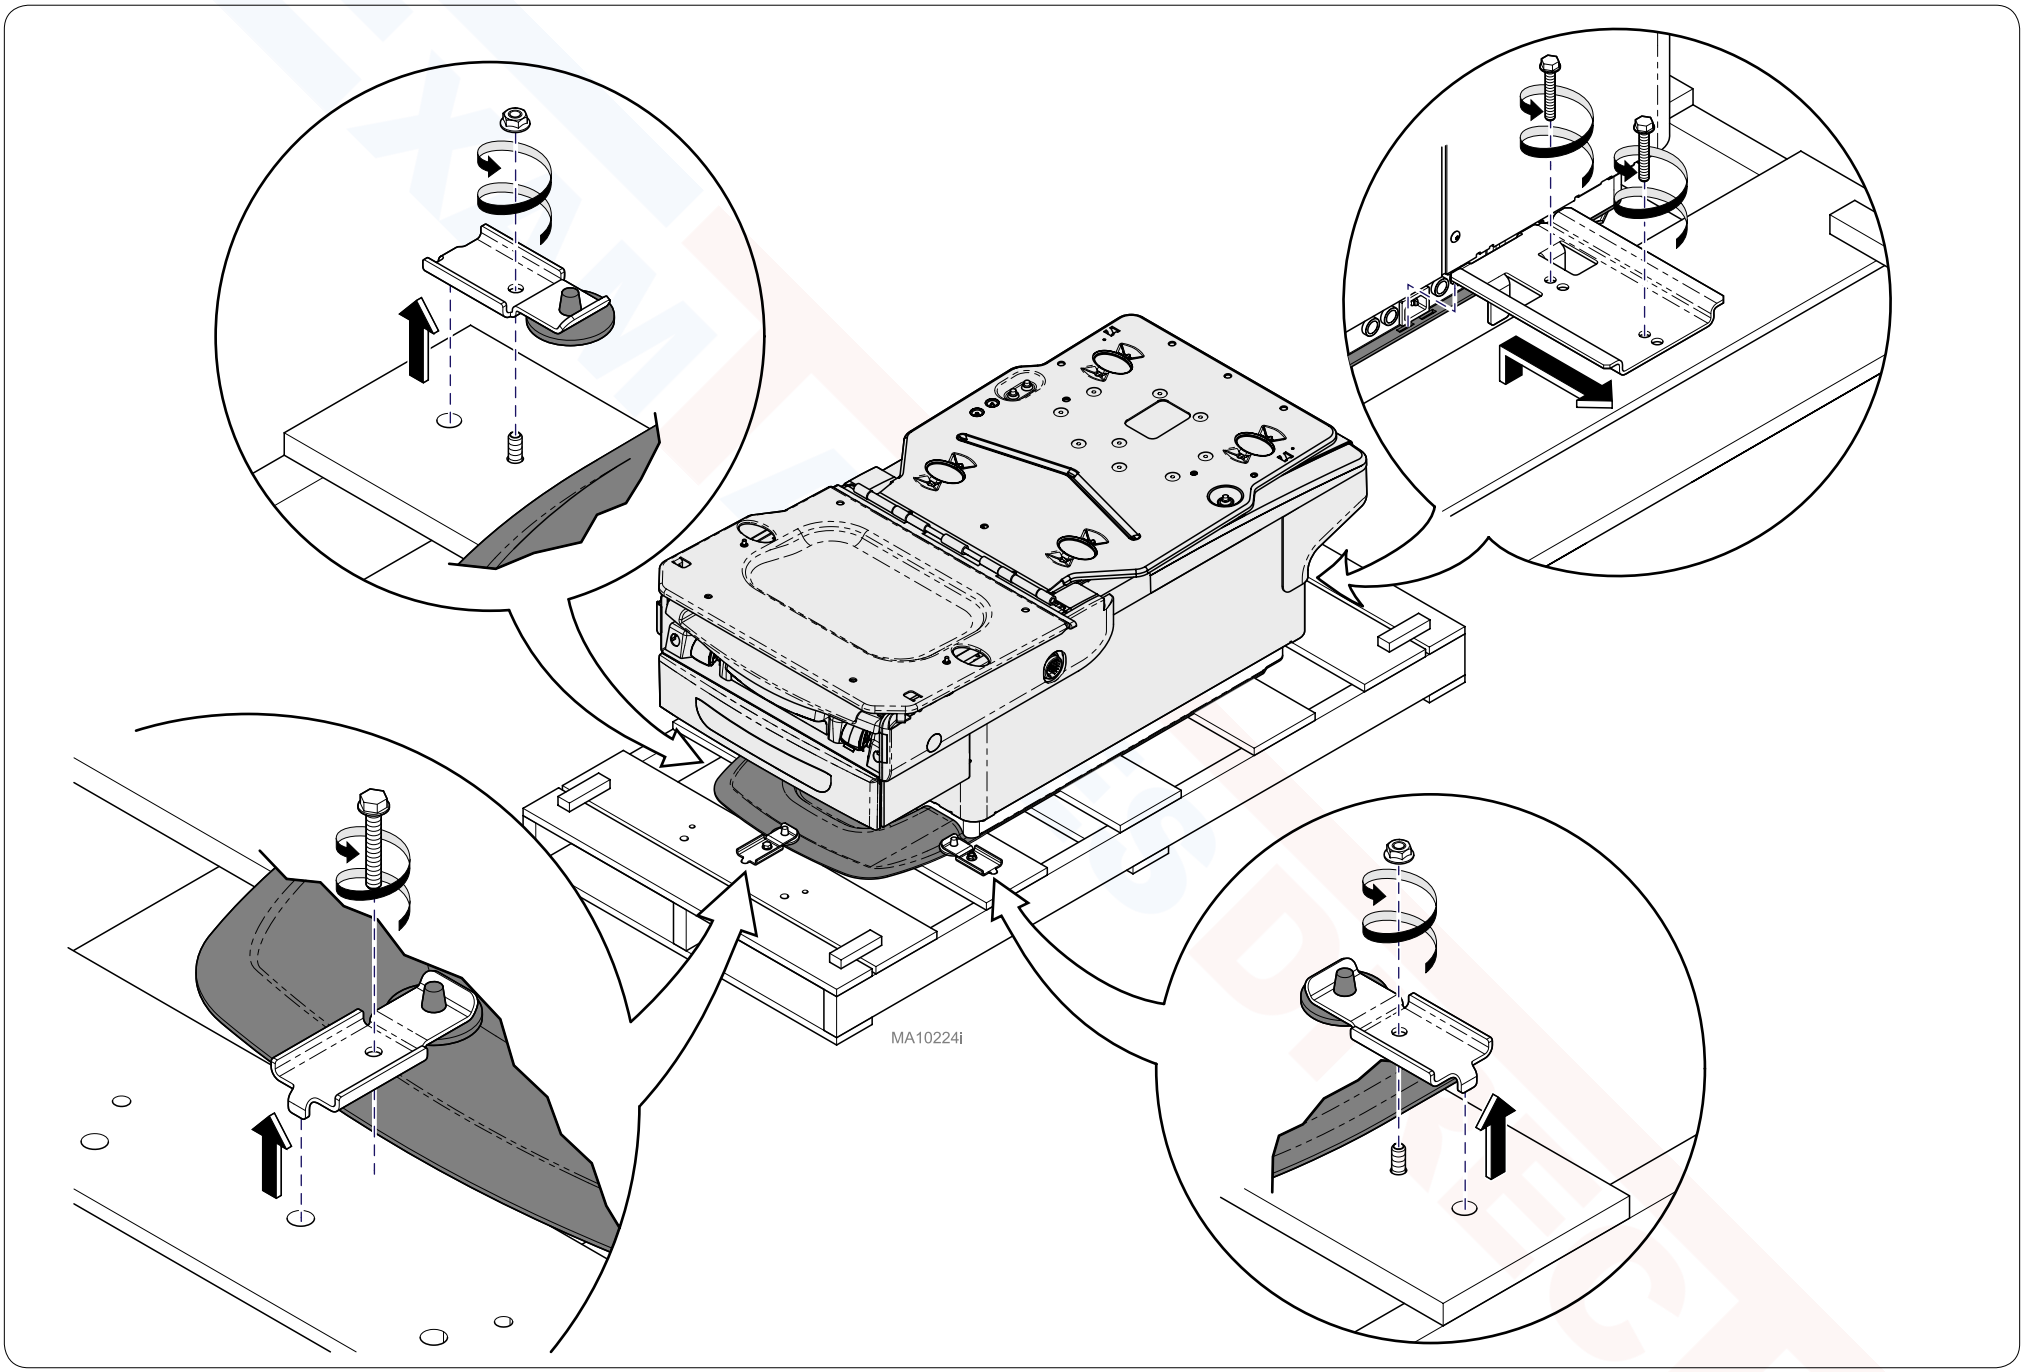


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

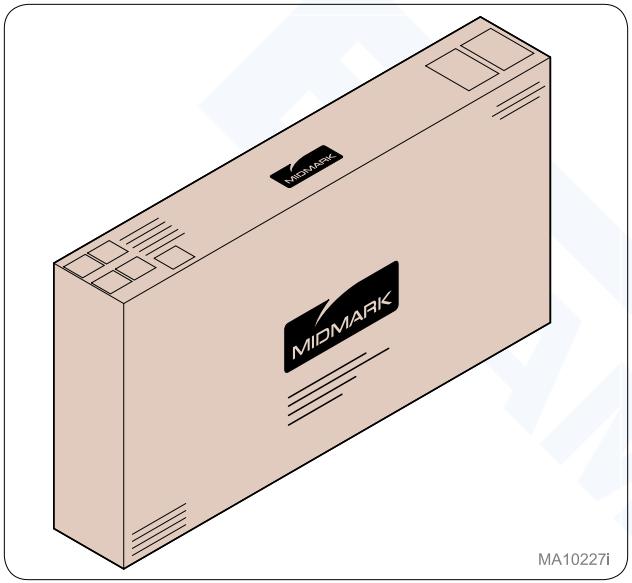


Étape 2 :
Repérer la boîte contenant la garniture.

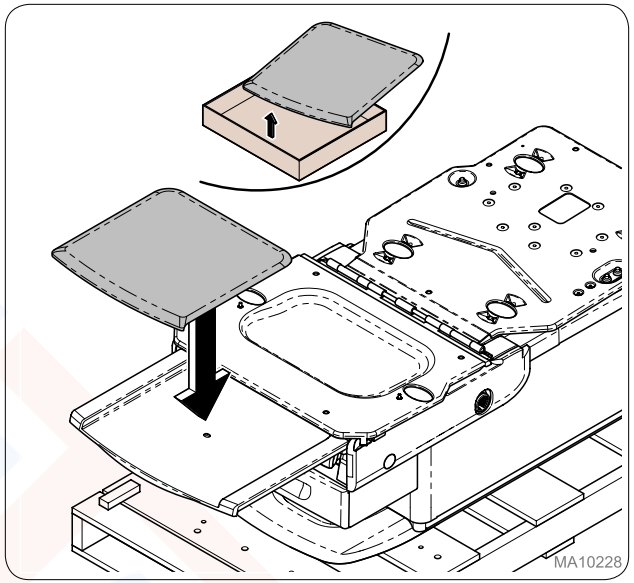


Étape 3 :
Placer la garniture du repose-pied, en insérant la tige située à l'arrière de la garniture à travers le trou du repose-pied.

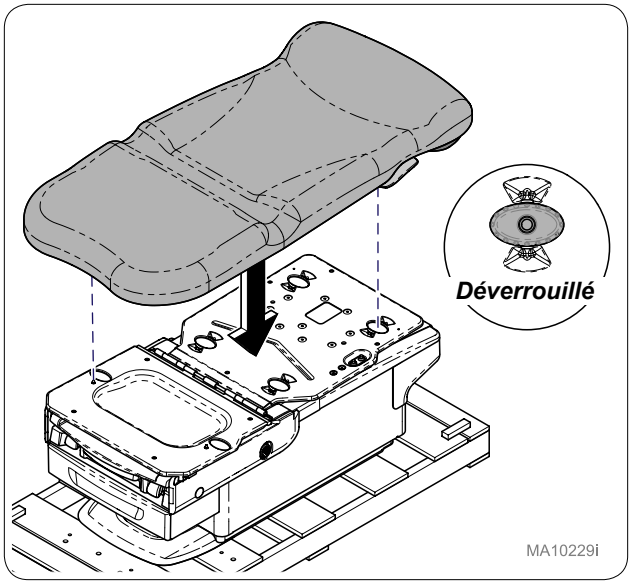


Étape 4 :
Avec les boutons de verrouillage (4) en position déverrouillée, placer la garniture sur le dessus du fauteuil en alignant les boutons de verrouillage avec les trous.

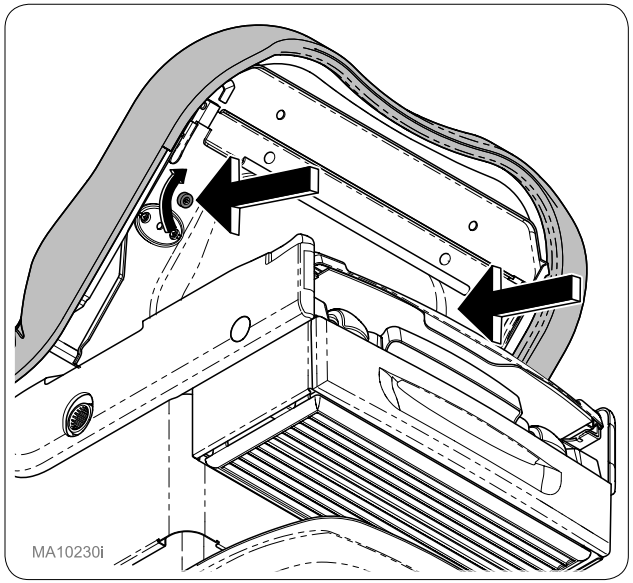

Étape 5 :
Relever l'assise à 90 degrés et fixer l'assise à l'aide des vis papillon fournies (2). Abaisser l'assise.

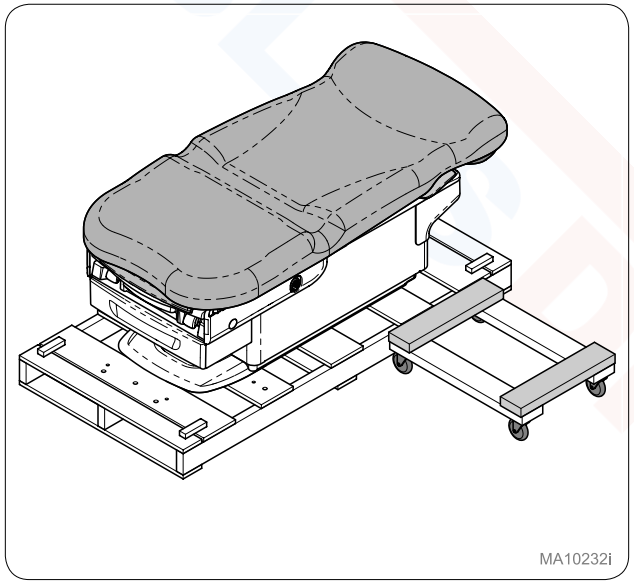


Étape 6 :
Placer le chariot à roulettes près de la tête du fauteuil.

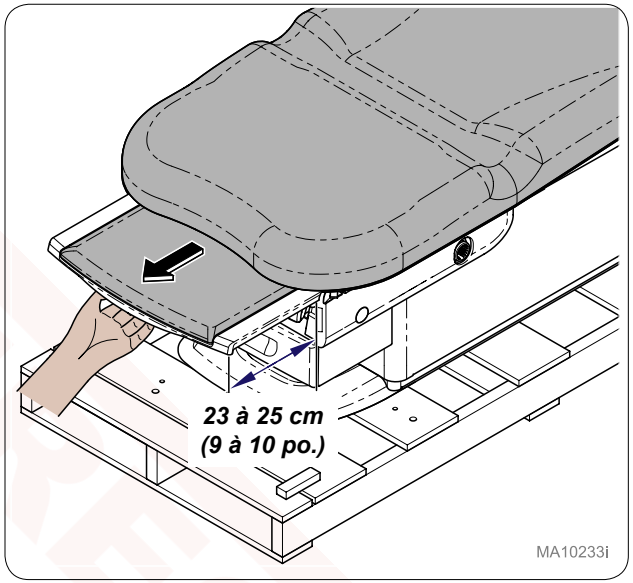


Étape 7 :
Sortir le repose-pied du fauteuil en le faisant glisser sur 23 à 25 cm (9 à 10 po.).

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 États-Unis | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com


TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169
003-10033-99
Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

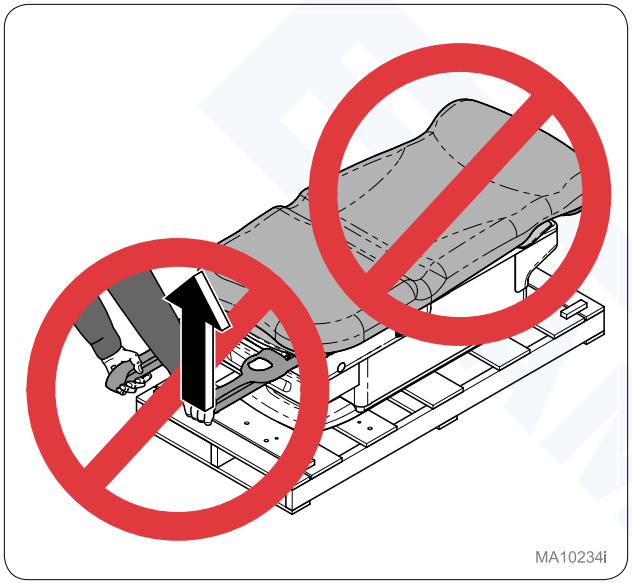


Avertissement concernant l'équipement
Ne *PAS soulever le fauteuil en le tirant par la garniture de revêtement ou les étriers.*

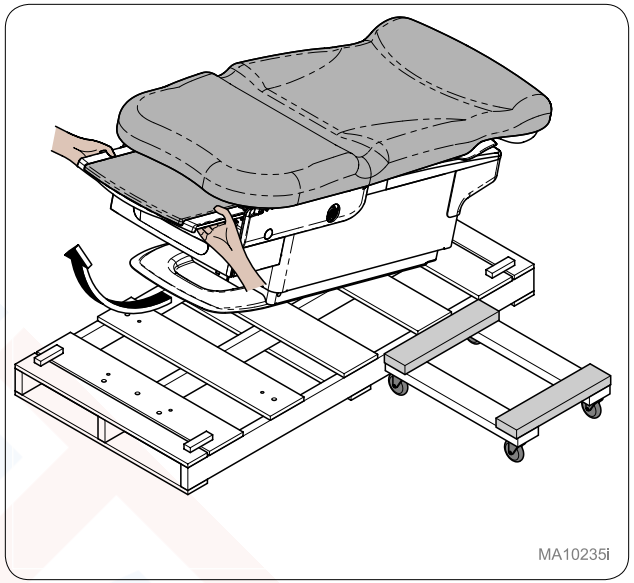


Étape 8 :
En appliquant les techniques de levage appropriées, soulever le fauteuil de la partie avant de la palette.

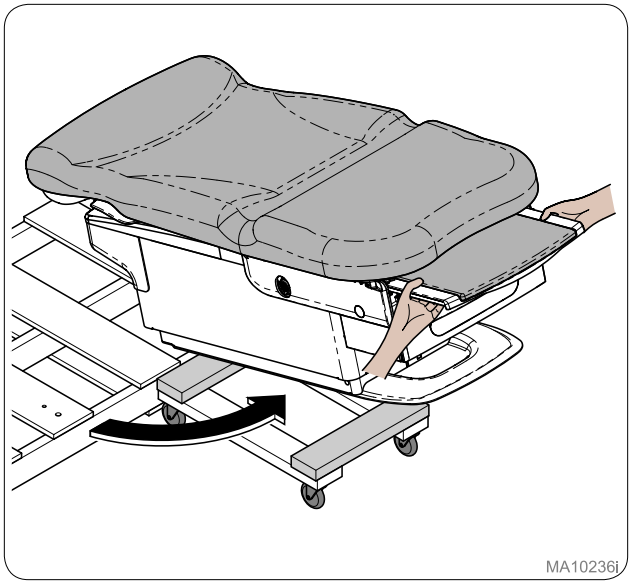


Étape 9 :
Faire pivoter le fauteuil en direction du chariot à roulettes.

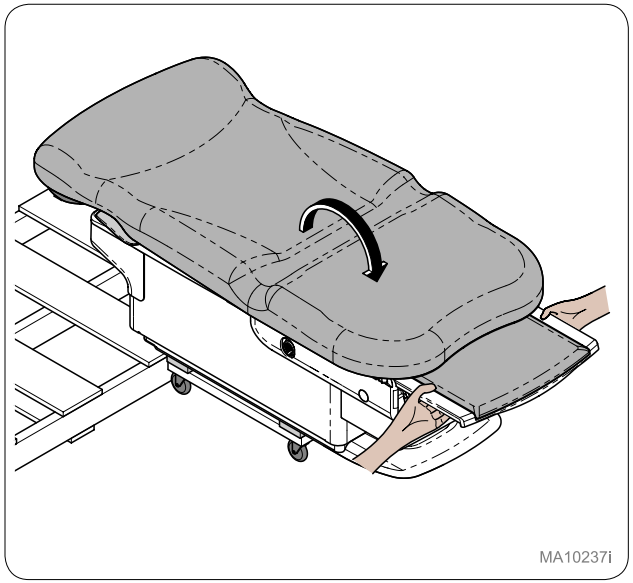

Étape 10 :
Abaisser le fauteuil sur le chariot.

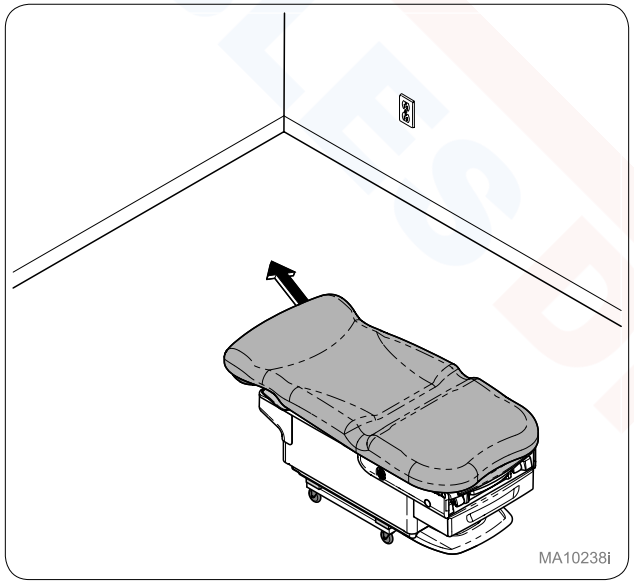

Étape 11 :
Placer le fauteuil à l'emplacement souhaité.

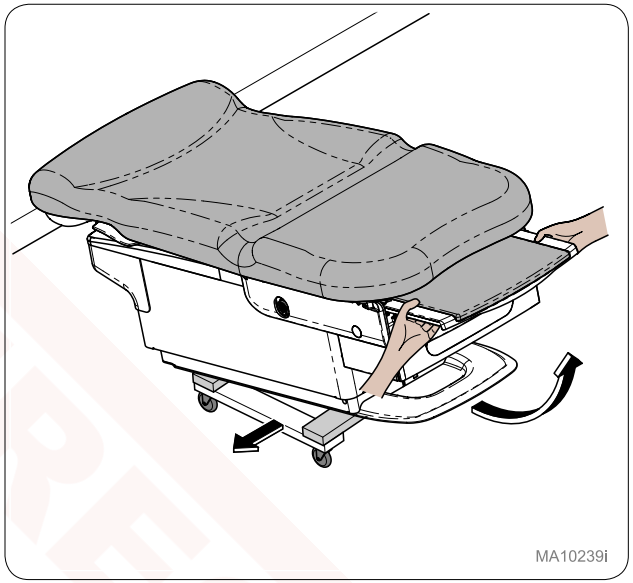


Étape 12 :
Retirer le fauteuil du chariot.

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 États-Unis | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est recommandé de contacter un électricien agréé de votre localité ou une autorité locale compétente en matière de distribution électrique interne dans les bâtiments pour vérifier que l'appareil, une fois sous tension, sera conforme à tous les codes électriques locaux, étatiques et fédéraux. Utiliser la puissance nominale indiquée sur l'appareil lors de la détermination de l'alimentation électrique appropriée pour le circuit de dérivation et la prise. Pour les modèles d'appareil d'une puissance nominale de 115 V avec un courant nominal égal ou supérieur à 12 A, un circuit de dérivation dédié peut être nécessaire si la protection du circuit de dérivation est fournie par un disjoncteur 15 A.

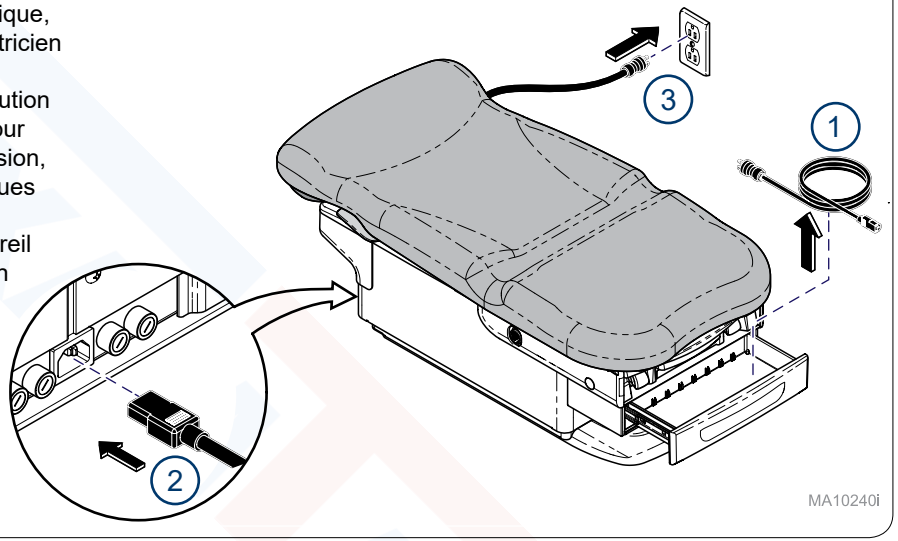


Étape 13 :

Retirer le cordon d'alimentation du tiroir, le brancher à la section arrière du fauteuil et le brancher ensuite dans une prise de courant murale ou de plancher.

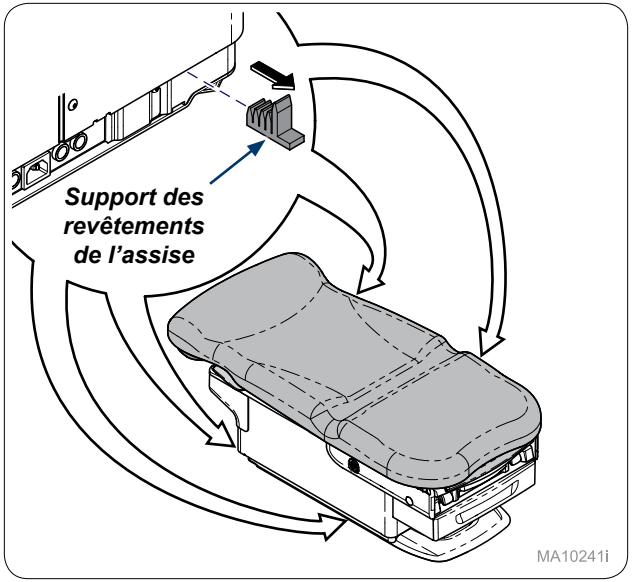


Étape 14 :

Retirer les supports des revêtements de l'assise (4).

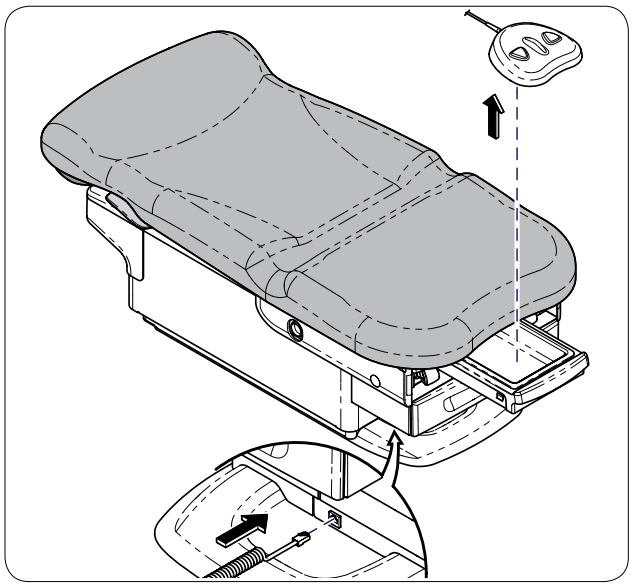


Étape 15 :

Retirer la pédale de commande de la table de traitement. Raccorder la pédale de commande à la base antérieure du fauteuil.

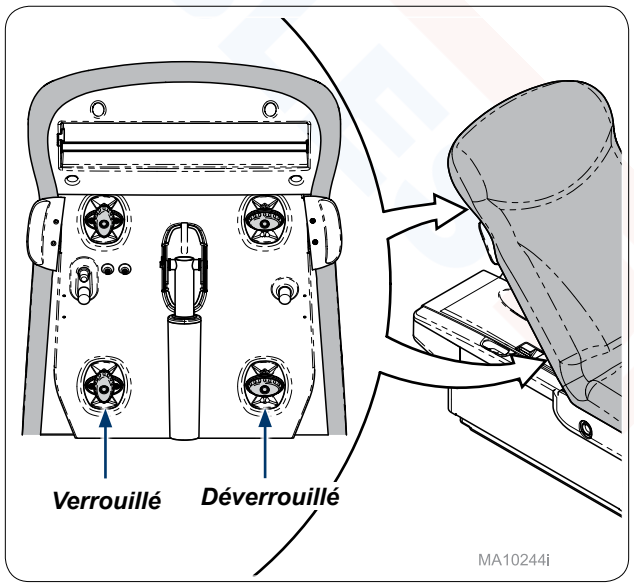

Étape 16 :

Relever le dossier et enclencher les boutons de verrouillage de la garniture (4).

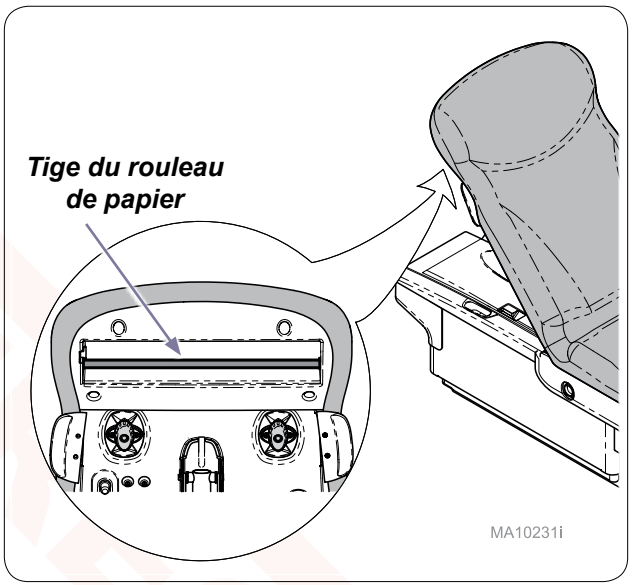

Étape 17 :

S'assurer que la tige du rouleau de papier est en place.


© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 États-Unis | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Avertissement concernant l'équipement


Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, le fauteuil doit être mis à niveau et stabilisé.

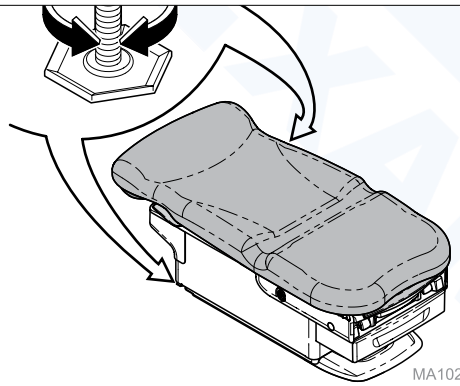

MA10245i

Étape 18 :

Ajuster les vis réglables (2) près de la tête du fauteuil pour mettre le fauteuil à niveau ou le stabiliser.

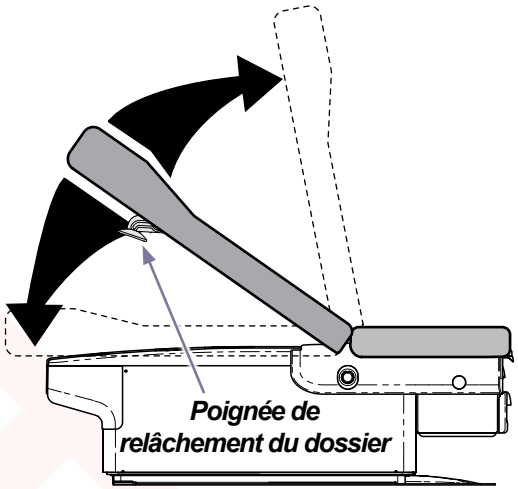


MA10246i

Étape 19 : (modèle 224 uniquement)

Vérifier le fonctionnement manuel correct du dossier.

Remarque

En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le +1-937-526-3662.

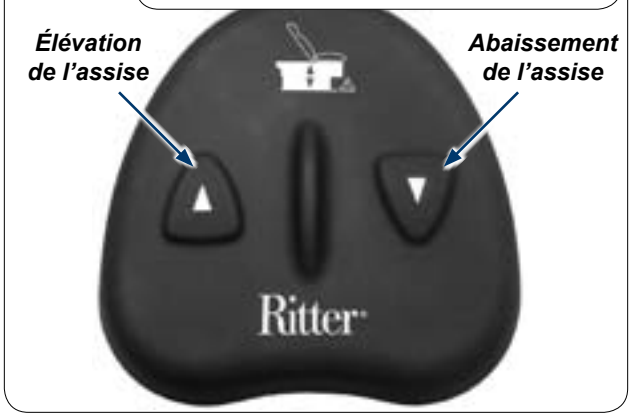


Étape 20 : (modèle 224 uniquement)

Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise.


Remarque

En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le +1-937-526-3662.

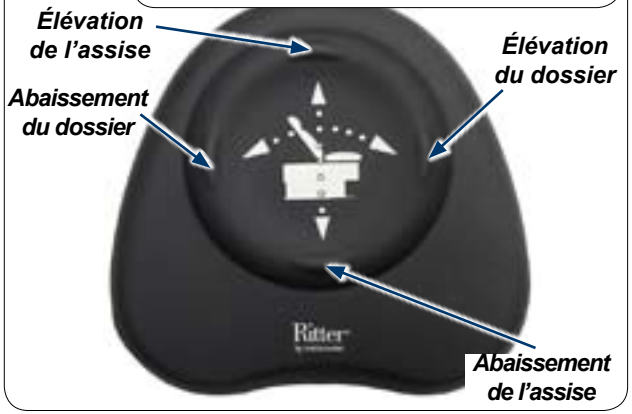

Étape 21 : (modèle 225 uniquement)

Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise et Monter/Descendre le dossier.

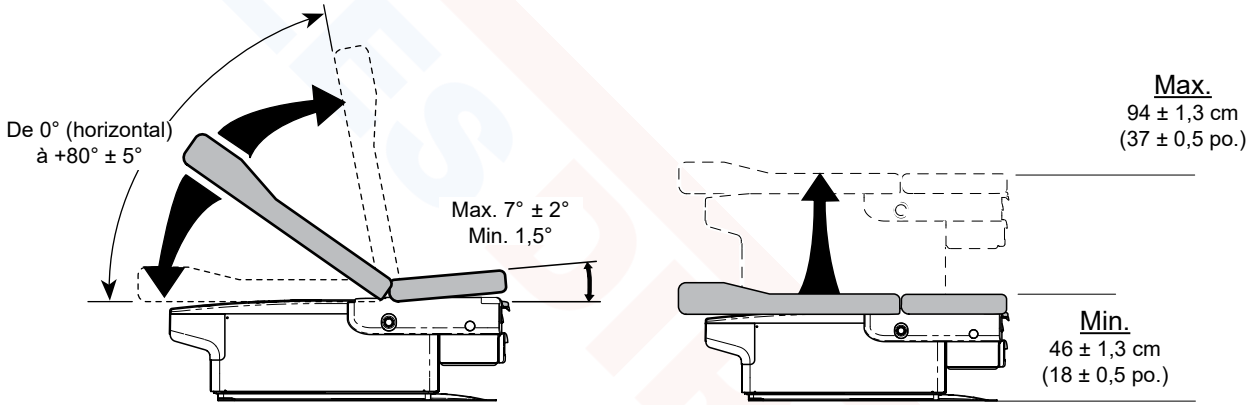

MA10249i

Plage d'inclinaison/de déplacement du fauteuil.

MIDMARK®
Because we care.

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 États-Unis | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Ritter® by MIDMARK

224 / 225 Sillón de exploración eléctrico Barrier-Free®
Instrucciones de instalación


Herramientas:
Taladro de batería / Destornillador de impacto
Juego de llaves convencionales
Juego de llaves de vaso profundas convencionales
Cúter para cartón
Plataforma móvil para muebles (4 ruedas)

Precaución
Objeto pesado. Utilice dispositivos de ayuda para la elevación o técnicas de elevación adecuadas para mover el sillón y evitar el riesgo de sufrir distensiones musculares o lesiones en la espalda.

Advertencia sobre el equipo
Para mover el sillón debe seguir las siguientes instrucciones.

SIEMPRE: *a) Transporte el sillón completamente bajado, con los soportes de la cubierta de la base colocados.*


NUNCA: *a) Haga presión sobre la cubierta de la base.*
b) Levante el sillón por los estribos, la sección trasera o la parte superior tapizada.

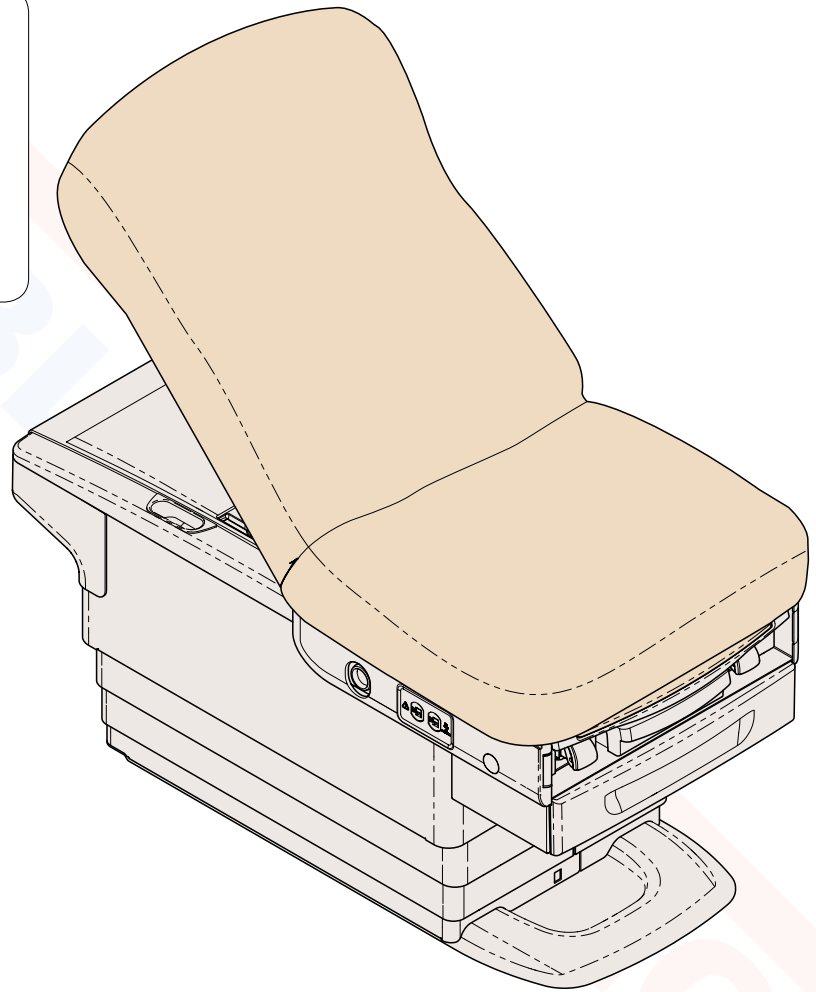

MA10250i

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com


Paso 1:
Retire los tornillos (4) de la plataforma para liberar el sillón.

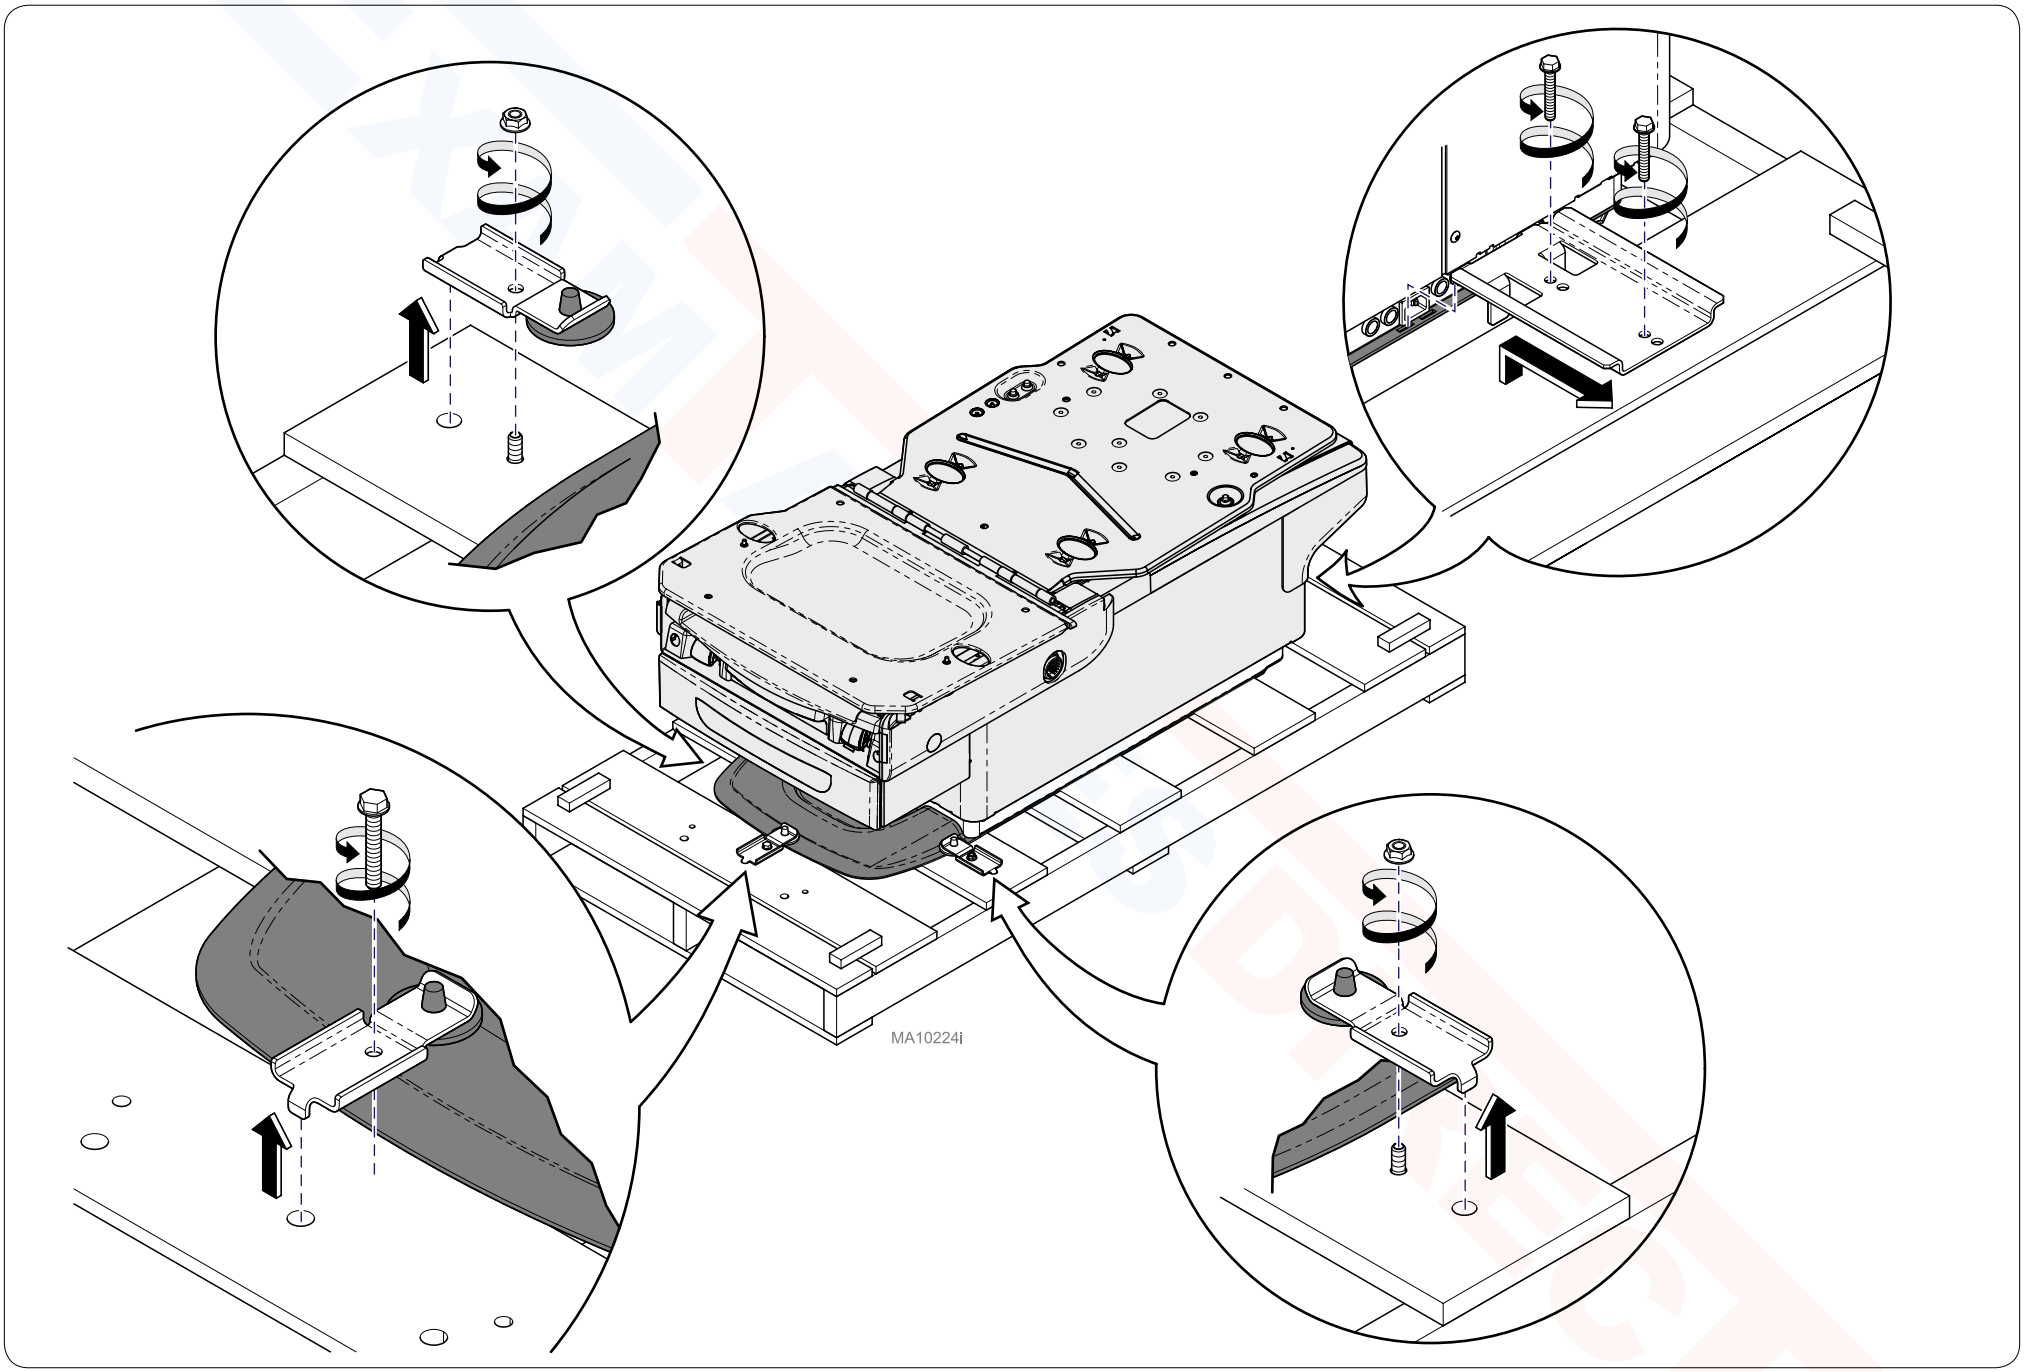


© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 EE. UU. | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

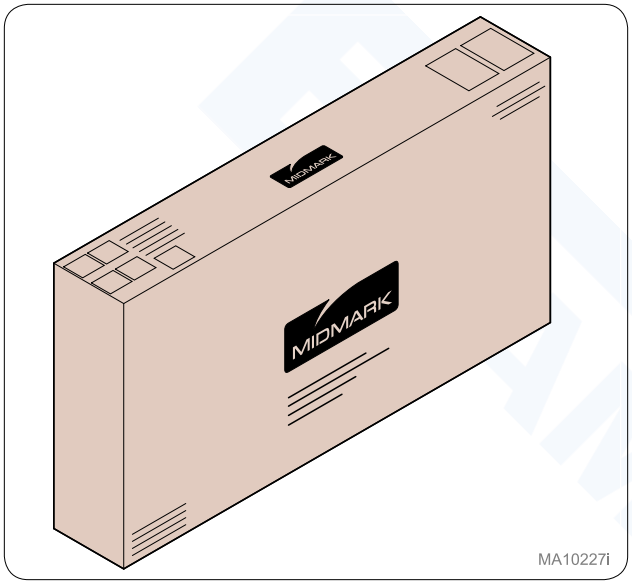


Paso 2:
Localice la caja que contiene la tapicería.

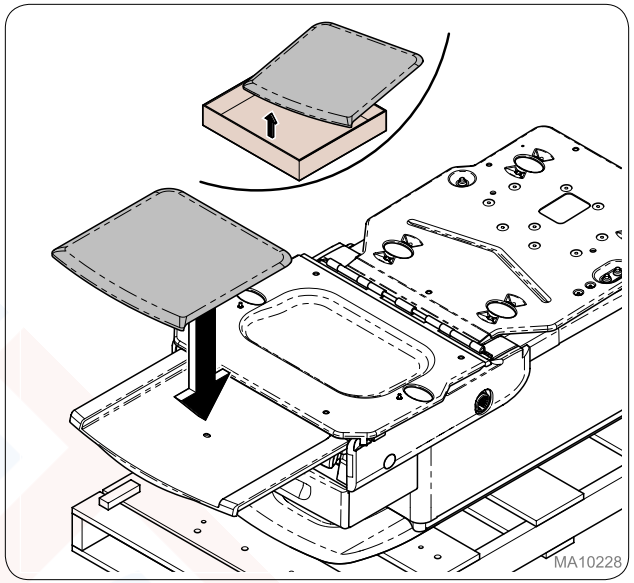


Paso 3:
Coloque la tapicería del reposapiés insertando la pieza de la parte inferior de la tapicería en el orificio de la estructura del reposapiés.

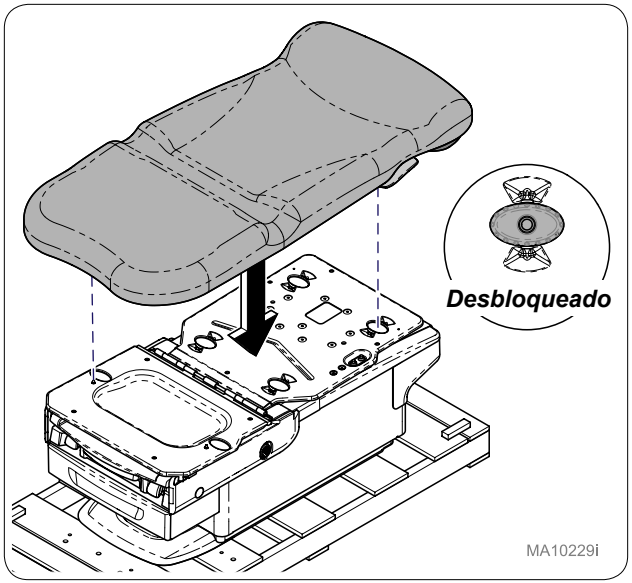


Paso 4:
Con los botones de bloqueo (4) en posición desbloqueada y coloque la tapicería sobre el sillón alineando los botones de bloqueo con los orificios.

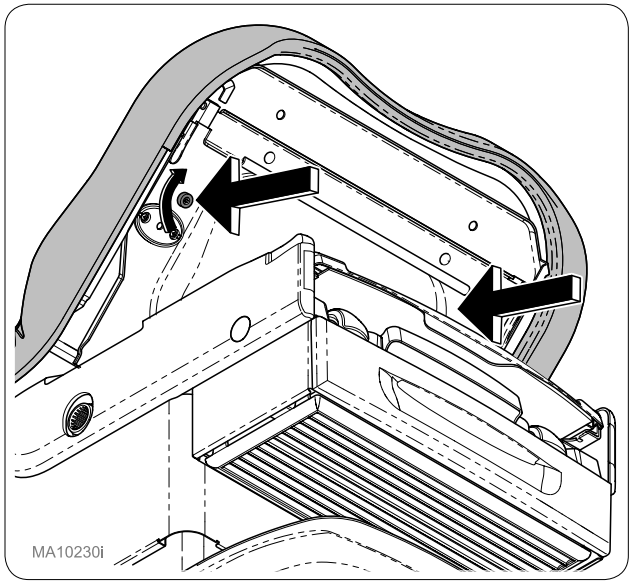

Paso 5:
Levante el asiento 90 grados y asegure la sección del asiento con tornillos de mariposa (2). Baje el asiento.

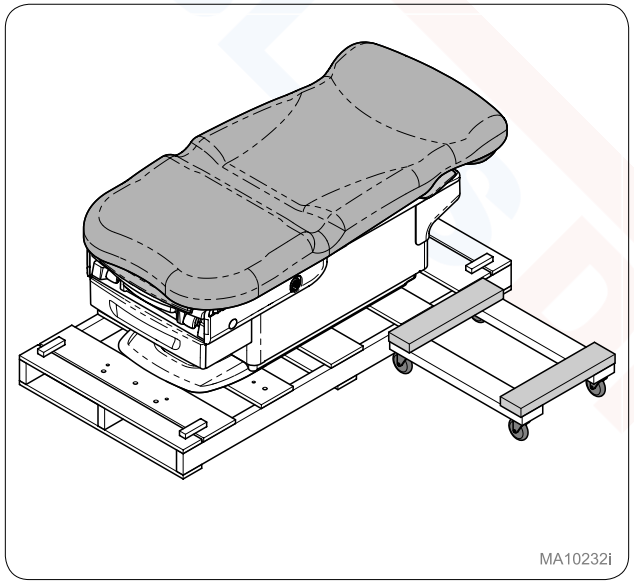

Paso 6:
Coloque la plataforma móvil a la altura del reposacabezas del sillón.

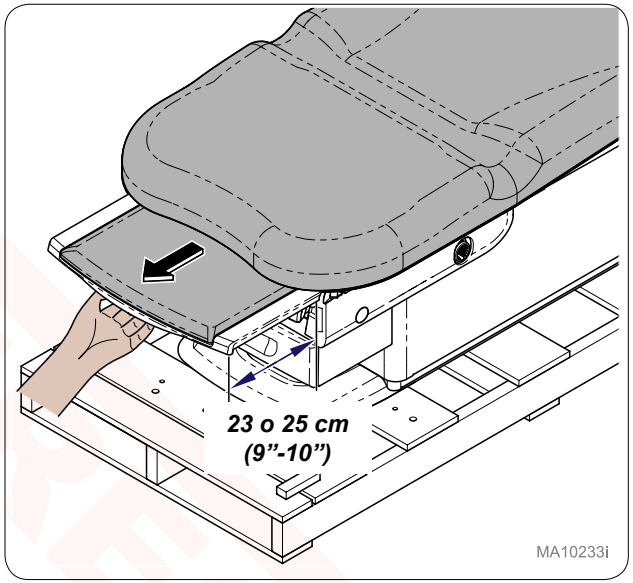


Paso 7:
Extraiga el reposapiés del sillón 23 o 25 cm (9”-10”).


© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 EE. UU. | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169


Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

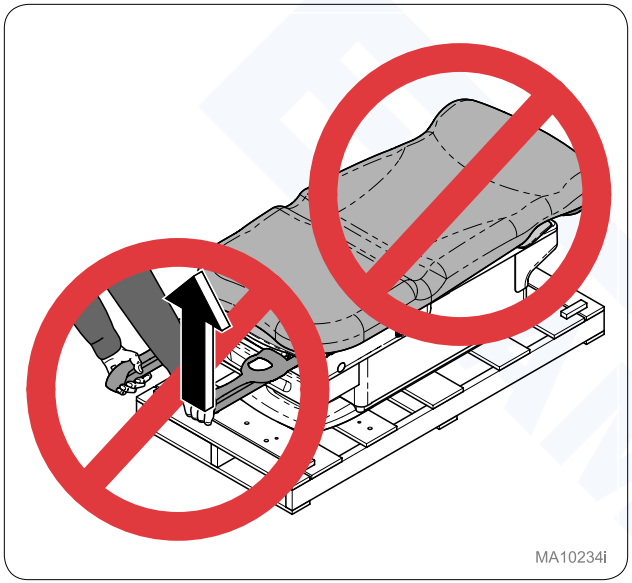


Advertencia sobre el equipo
NO *levante el sillón por la tapicería ni los estribos.*

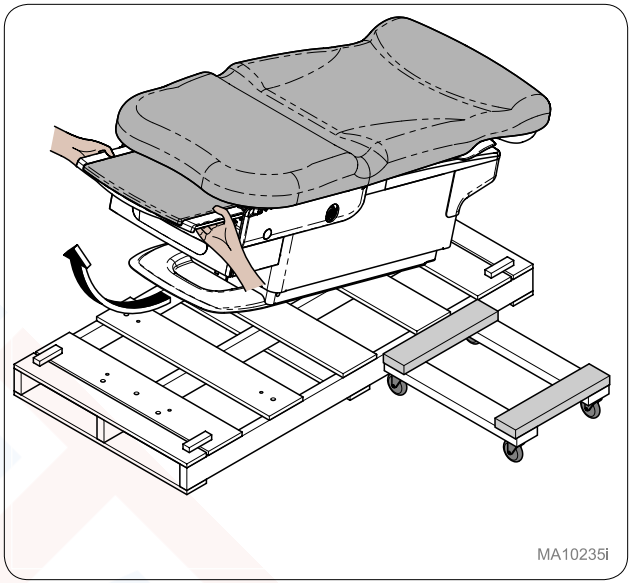


Paso 8:
Utilizando la técnica de elevación adecuada, levante el sillón por la parte delantera de la plataforma.

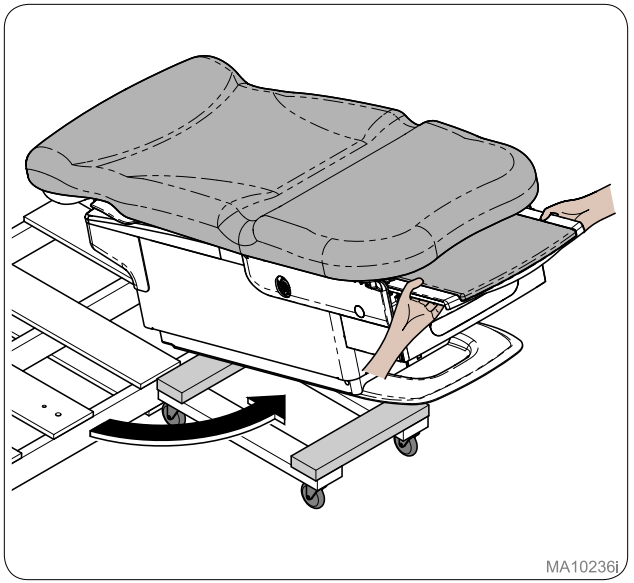


Paso 9:
Gire el sillón hacia la plataforma móvil.

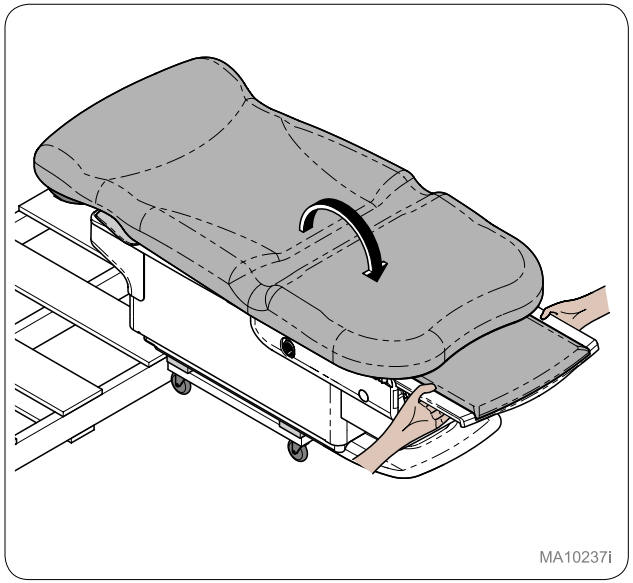

Paso 10:
Deposite el sillón sobre la plataforma móvil.

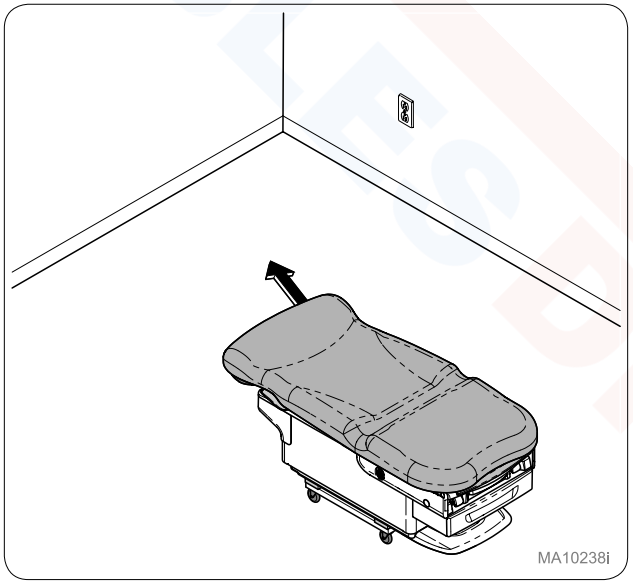

Paso 11:
Mueva el sillón hasta el lugar deseado.

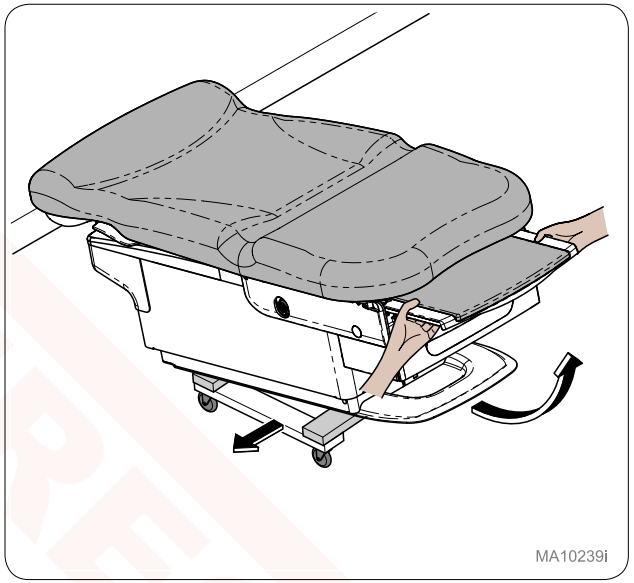


Paso 12:
Retire el sillón de la plataforma móvil.

© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 EE. UU. | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com


TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com


Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales, autonómicos y nacionales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida. Para modelos de 115 V con una calificación de corriente de 12 amperios o más, puede requerirse un circuito dedicado en caso de que la protección de dicho circuito provenga de un disyuntor de 15 amperios.

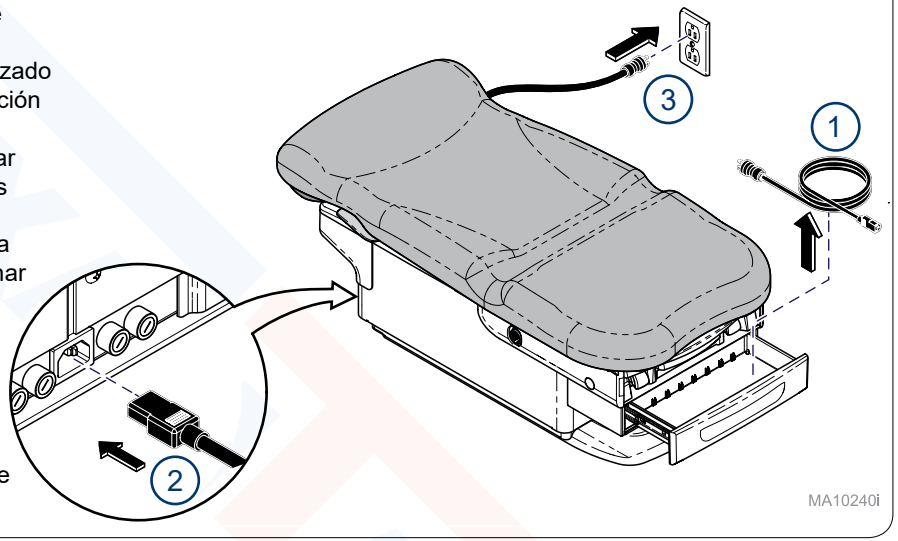


Paso 13:
Saque el cable de alimentación del cajón, conéctelo a la parte trasera del sillón y enchúfelo a la toma de la pared o del suelo.

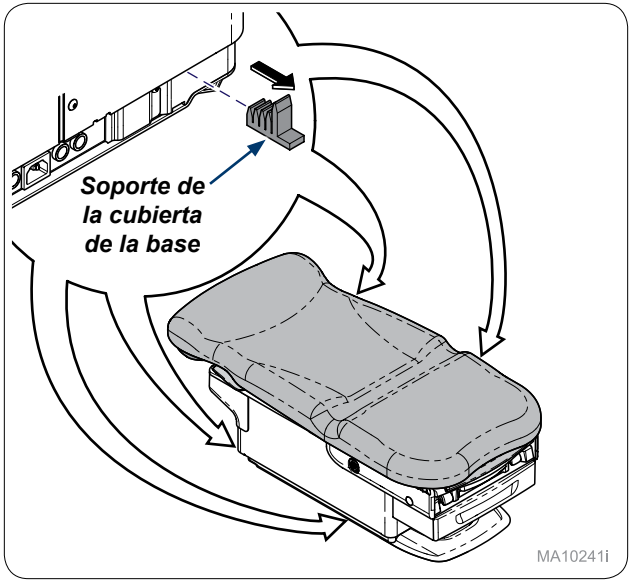


Paso 14:
Retire los soportes de la cubierta de la base (4).

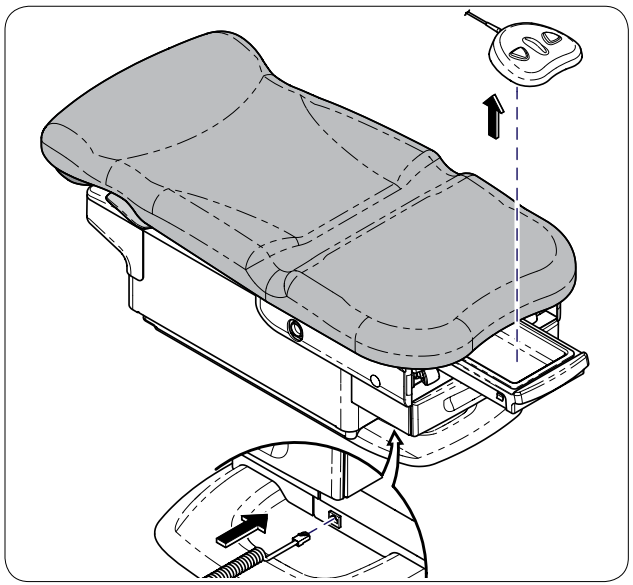

Paso 15:
Retire el pedal de control de la bandeja de tratamiento. Conecte el pedal de control a la base frontal del sillón.

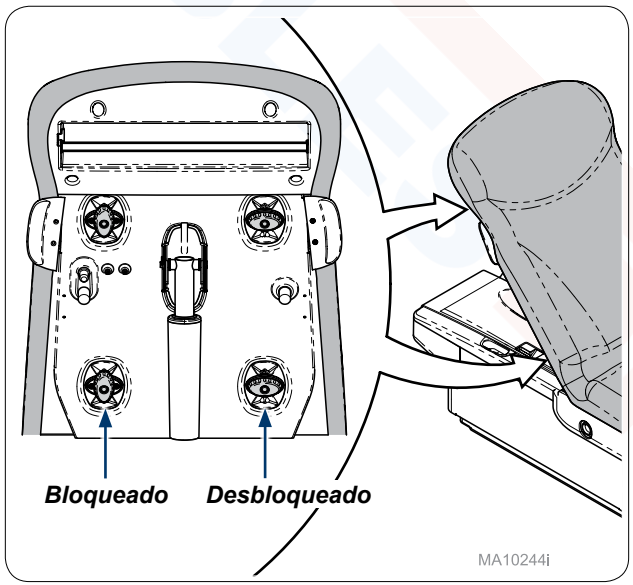

Paso 16:
Levante el respaldo y cierre los botones de bloqueo (4) de la tapicería.

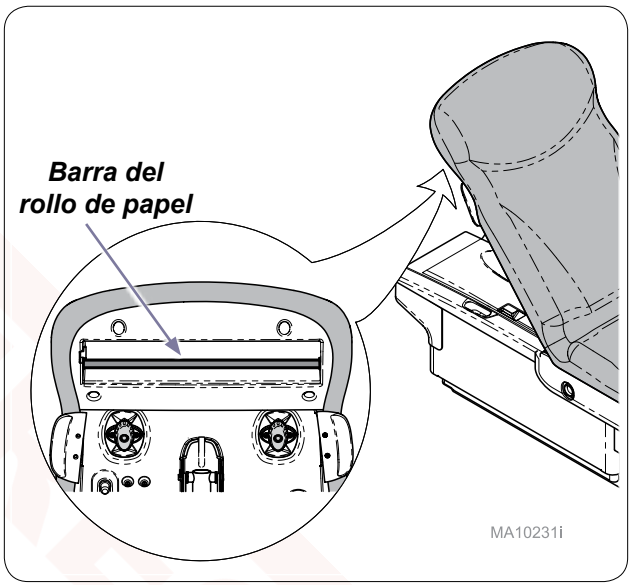

Paso 17:
Asegúrese de que la barra del rollo de papel esté colocada.


© 2017 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 EE. UU. | 1-800-643-6275 | +1-937-526-3662 | midmark.com

TP201 20-42-FO-00013 Rev A1 C2169

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com

Advertencia sobre el equipo


El sillón debe estar nivelado o fijo para su correcto funcionamiento.

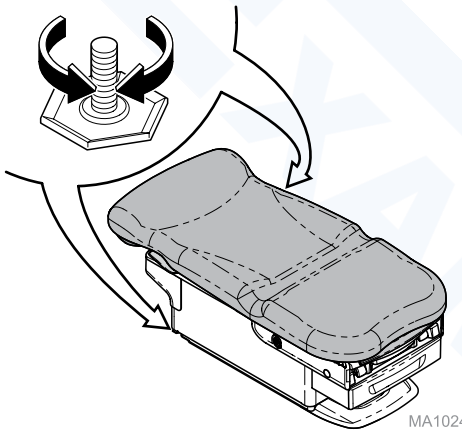

MA10245i

Paso 18:

Ajuste los tornillos de nivelación (2) que se encuentran a la altura del reposacabezas del sillón para nivelarlo o bascularlo.

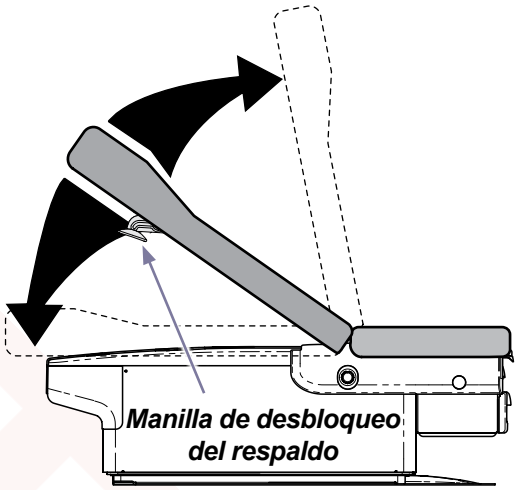


MA10246i

Paso 19: (Solo para 224)

Compruebe el correcto funcionamiento manual del respaldo.

Nota

Si detecta algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: +1-937-526-3662.

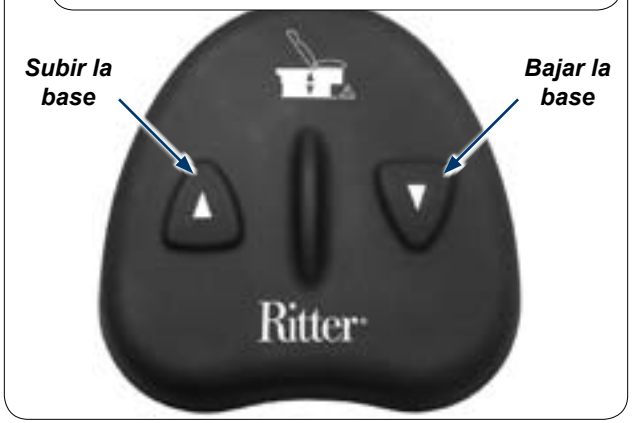

Paso 20: (Solo para 224)

Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base.


Nota

Si detecta algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: +1-937-526-3662.



Paso 21: (Solo para 225)

Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base y Subir/bajar respaldo.

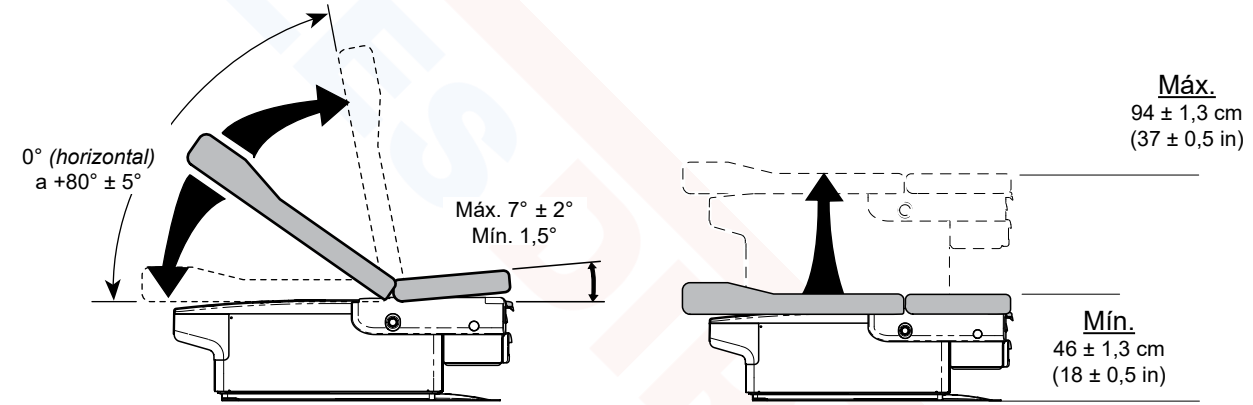

MA10249i

Amplitud de movimiento del sillón.

Shop tables & accessories at ExamTablesDirect.com